


F&P Evatherm™ 900MR810

(For use with Fisher & Paykel MR810 humidifier only)

Flow: ≥5 LPM to ≤60 LPM


900MR810

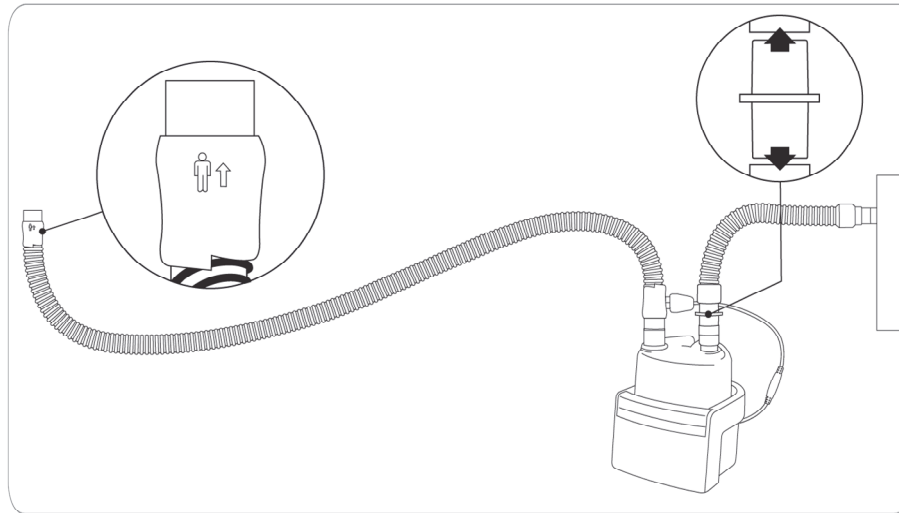

Cleaning/Disinfection:

Use only approved disinfection and cleaning methods as shown:


Step 1. Cleaning:

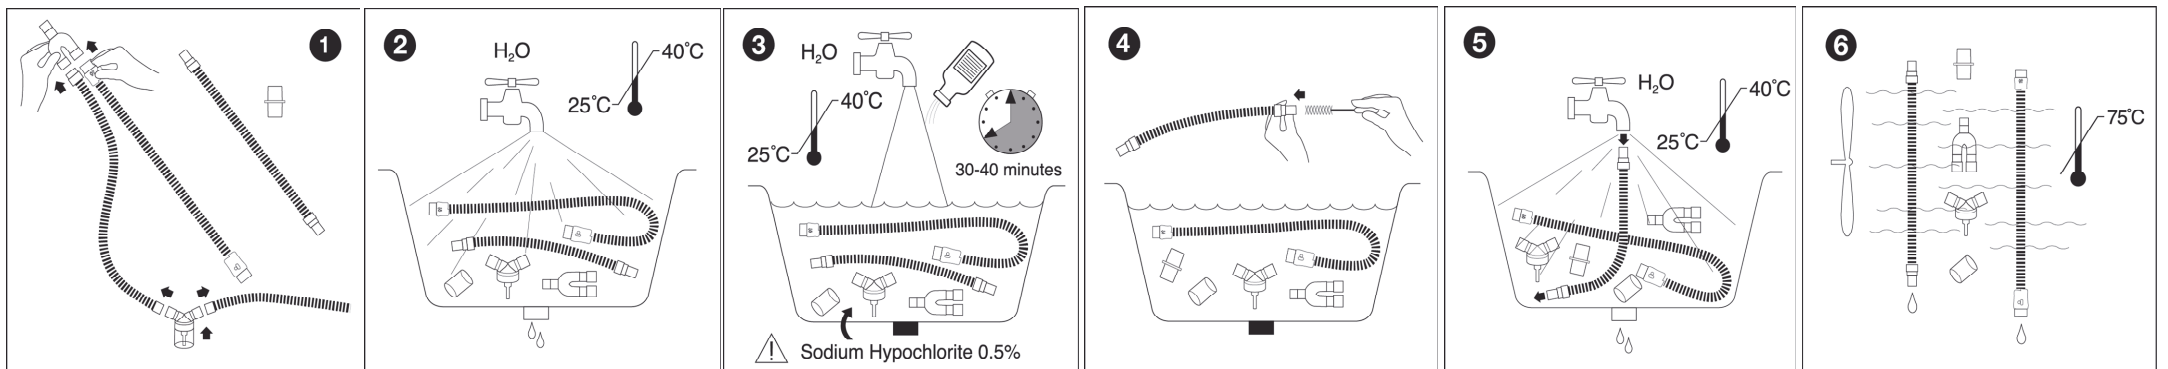


Step 2. High-level Disinfection:

Use one of the disinfection methods shown:


a) Chemical

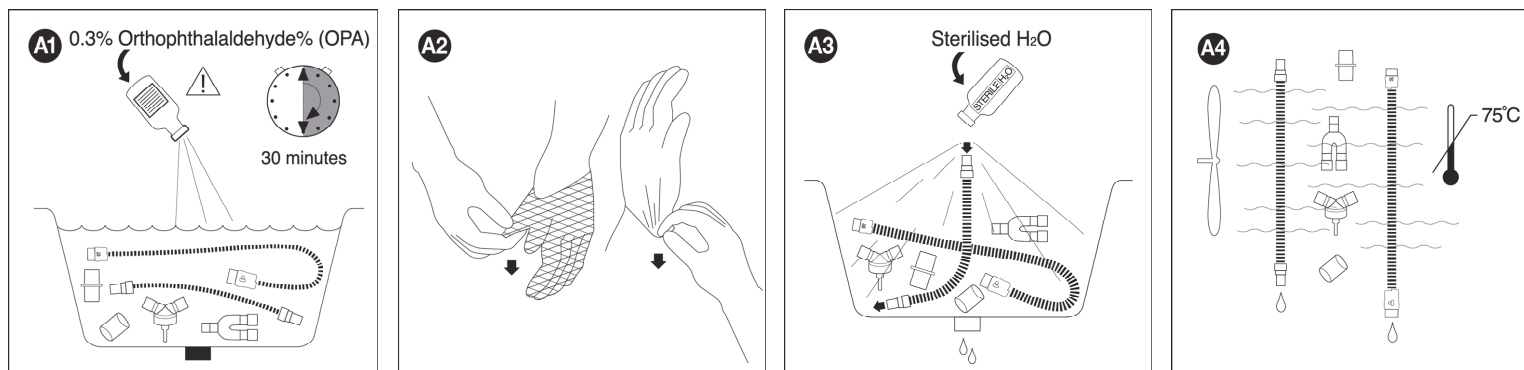

b) Pasteurization

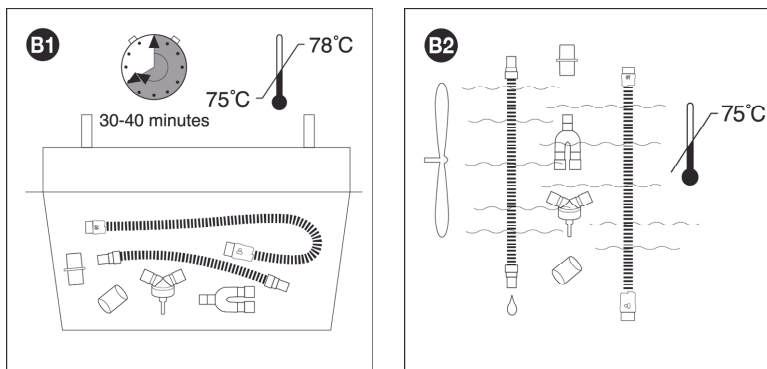


c) Autoclave (connectors only)

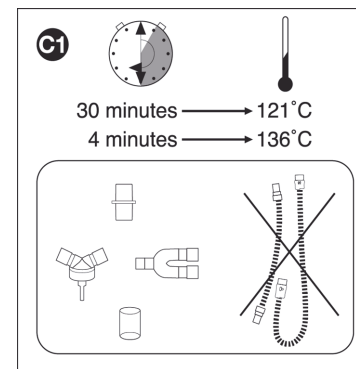

CE0123 Rx only

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Manufacturer Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.co.nz Web: www.fphcare.com
Importer/ Distributor Australia (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131. Tel: +61 3 9871 4900 Fax: +61 3 9871 4998 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 **Benelux** Tel: +31 40 216 3555 Fax: +31 40 216 3554 **Brazil** Fisher & Paykel do Brasil, Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, Paraíso, 04004-000, São Paulo – SP, Brazil Tel: +55 11 2548 7002 **China** 代理人/售后服务机构:费雪派克医疗保健(广州)有限公司, 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12栋301号 电话: +86 20 32053486 传真: +86 20 32052132 **Denmark** Tel: +45 70 26 37 70 Fax: +46 83 66 310 **Finland** Tel: +358 94 1590 355 Fax: +46 83 66 310 **France** Fisher & Paykel Healthcare SAS, 10 Av. du Québec, Bât. F5, BP 512, Villebon-sur-Yvette, 91946 Courtaboeuf Cedex, France Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 Email: c.s@fphcare.fr **Germany** Fisher & Paykel Healthcare GmbH & Co. KG, Deutschland, Österreich, Schweiz, Wiesenstrasse 49, D 73614 Schomdorf, Germany Tel: +49 7181 98599 0 Fax: +49 7181 98599 66 **Hong Kong** Tel: +852 2116 0032 Fax: +852 2116 0085 **India** Tel: +91 80 2309 6400 **Ireland** Tel: 1800 409 011 Fax: +44 1628 626 146 **Italy** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 5117 7110 Fax: +81 3 5117 7115 **Korea** Tel: +82 2 6205 6900 Fax: +82 2 6309 6901 **Norway** Tel: +47 21 60 13 53 Fax: +47 22 99 60 10 **Russia** Tel. and Fax: +7 495 782 21 50 **Spain** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Sweden** Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10 **Switzerland** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Taiwan** Tel: +886 2 8751 1739 Fax: +886 2 8751 5625 **Turkey** İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri: Ostim Mahallesi 1249. Cadde No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374, Tel: +90 312 354 34 12 Fax: +90 312 354 31 01 **UK** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tel: 0800 132 189 Fax: +44 1628 626 146 **USA/Canada** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4001

English  Refer to MR810 humidifier user instructions for further set up and correct use information.

Intended Use

The Fisher & Paykel Healthcare 900MR810 adult breathing circuit is designed for use with the MR810 humidifier in order to provide therapeutic levels of heat and humidity to a patient's inspired respiratory gases, when using a continuous or intermittent ventilator system or a continuous gas flow system.

Addition of heat and humidity to the supply of cold and dry respiratory gases provided through ventilation is beneficial to prevent drying of the patient airways. The MR810 System is designed for use in hospitals, long term care facilities and homes under the prescription of a qualified medical professional.

Symbol:  Patient End

Cleaning/Disinfection

Use only approved disinfection and cleaning methods as set out in these instructions:



Discard tubes and all circuit components after 20 cleaning cycles, or six months after first use, whichever occurs earlier.
Do not exceed maximum recommended cleaning temperatures as higher cleaning temperatures may damage the circuit.
Do not use automated washer/cleaner as it may damage the circuit.

Cleaning and disinfection instructions:

Step 1 – Cleaning:



Caution: When cleaning, wear appropriate personal protection equipment, such as: disposable gloves, splash visor/safety glasses and protective gown.

- Dis-assemble the circuit
NOTE: Clean circuit as soon as possible after use.
- Rinse circuit components directly after use with warm tap water (<40°C).
- Fill a sink/container with warm water (<40°C) and Sodium Hypochlorite to 0.5% maximum concentration. Then soak tubing and components for 30–40 minutes.
- Clean the inside of the tube removing all visible debris, if needed, with a soft bottle brush. Do not use hard brushes inside the tube.
- Rinse the inside and outside of the tube thoroughly with warm tap water to remove the remaining Sodium Hypochlorite and debris.
- Hang the tubes vertically upright to remove excess water. Tubes can be air dried up to 75°C.



Warning: Do not clean or dry circuit with solvents or alcohol.

Step 2 – High-level Disinfection:

Use one of the disinfection methods shown:

a. Disinfection with 0.3% orthophthalaldehyde (OPA) chemical:



Caution: Before handling OPA
Wear appropriate personal protection materials, such as: disposable gloves, splash visor/safety glasses and protective gown. Ensure disinfection is performed in a fume cupboard or with fume extraction. Read OPA manufacturers instructions for use.

- Fill sink/container with disinfectant OPA 0.3%, such as Johnson and Johnson Cidex OPA (follow manufacturer instructions for correct preparation of OPA).
Submerge tube and components fully in disinfectant.
Soak for a minimum of 30 minutes. Then remove all parts from the OPA.
- Change gloves.
- Rinse tubes and components with sterile water (follow manufacturer instructions for correct rinsing procedure of OPA).
- Hang the tubes vertically to let them air dry. Tubes can be air dried up to 75°C.
Inspect tube and circuit components, check for any cracks or tears or damage.
When all components are dry re-assemble the breathing circuit.
Store circuit in a dry and dust free environment ready for next use.

b. Disinfection by Pasteurization:

- Ensure pasteurizer set to control between 75 and 78°C maximum.
NOTE: Temperatures higher than 78°C will damage the breathing tube and shorten its life.
Leave circuit components in pasteurizer for between 30 to 40 minutes.
- Remove circuit components, hang the tubes to dry vertically. Tubes can be air dried up to 75°C.
Inspect tube and circuit components, check for any cracks or tears or damage.
When all components are dry re-assemble the breathing circuit.
Store circuit in a dry and dust free environment ready for next use.

c. Autoclave:



Warning: Only the circuit connectors can be autoclaved. Autoclaving will destroy the tubes.

- Ensure the autoclave is set at either 121°C or 136°C.
Leave circuit connectors in autoclave for 30 minutes at 121°C or 4 minutes at 136°C.
Inspect circuit connectors, check for any cracks or damage.
When all connectors are dry, re-assemble the circuit connectors to disinfected tubing.
Store circuit in a dry and dust free environment ready for next use.

Technical Specifications:



Type BF

Interface connections: ISO 5356-1 or ISO 5367
Ambient temperature and inlet gas operating range: 18°C – 26°C
Maximum delivered temperature: <40°C

	900MR810
Compliance:	4.6 mL/kPa/m
Compressible volume:	640 mL
Leakage rate:	<25 mL/min @ 6 kPa
Resistance to flow at rated flow:	0.4 cmH ₂ O @ 60 ± 1 L/min
Flow range:	≥5 to ≤60 L/min*

* Tested with MR370 chamber




Warning:

- Clean circuit prior to use and after each patient use, using approved disinfection methods only. Use of unapproved cleaning methods may damage the circuit and reduce its useable life.
- Must be set up and used by a trained medical professional.
- Inspect circuit before re-use, do not use if the circuit shows signs of deterioration, such as: cracks, tears, or damage.
- Use only with Fisher & Paykel MR810, humidification chambers and accessories.
- Ensure that the humidifier is always positioned lower than the patient.
- Do not fill the chamber with water in excess of 37°C.
- Set appropriate ventilator alarms.
- Ensure connector with patient symbol is located at patient end of circuit.
- Use a watertrap in the expiratory limb when applicable.
- Check all tube connections are tight before use.
- Perform a pressure and leak test on the breathing system, and check for occlusions, before connecting to a patient.
- Ensure the complete circuit functions correctly with required ventilator settings, before connecting to a patient.
- Check circuit tubing and watertraps for condensate regularly, and drain as required.
- Do not use the heated breathing circuit without gas flow. If gas flow is interrupted turn the humidifier off.
- Do not cover the circuit with materials such as blankets, towels or bed linen.
- Surface temperature may reach 43°C. Prolonged contact of circuit tube with exposed patients' skin may result in pressure injury or skin damage.
- Do not crush the circuit tube.
- Humidity output of this system can be compromised if used outside recommended ambient temperature or flow range.
- No modification to this equipment is allowed.
- Disconnect tube by handling end connectors only, do not pull or twist tubing, as this may cause damage.
- Check the water level in the humidification chamber regularly and top up as required.
- Do not expose tubes to excessive UV radiation.
- Discard tubes and all circuit components after 20 cleaning cycles, or six months after first use, whichever occurs earlier. At end of product life, disinfect the circuit, then dispose of as uncleaned/contaminated medical waste.
- California residents please be advised of the following, pursuant to Proposition 65: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. For more information, please visit: www.fphcare.com/prop65

Warranty Statement:

Fisher & Paykel Healthcare warrants that the Evatherm™ circuit, when used in accordance with its instructions for use, shall be free from defects in workmanship and materials and will perform in accordance with Fisher & Paykel Healthcare's official published product specifications for a period of 90 days from the date of purchase by the end user. This warranty is subject to the limitations and exceptions set out in detail in <http://www.fphcare.com/evalthermwarranty>

Français  Consulter les instructions d'utilisation de l'humidificateur MR810 pour obtenir des informations supplémentaires sur la configuration et l'utilisation correcte.

Domaine d'application

Le circuit respiratoire pour adulte 900MR810 de Fisher & Paykel Healthcare est destiné à être utilisé avec l'humidificateur MR810 afin de fournir des niveaux thérapeutiques de chaleur et d'humidité aux gaz respiratoires inspirés par un patient, lors de l'utilisation d'un système de ventilation à débit constant ou intermittent ou d'un système de débit de gaz continu.

L'ajout de chaleur et d'humidité aux gaz respiratoires froids et secs fournis par ventilation est bénéfique afin de prévenir le dessèchement des voies aériennes des patients. Le système MR810 est conçu pour être utilisé dans les hôpitaux, institutions de soins à long terme et à domicile sur prescription d'un professionnel de santé qualifié.

Symbole :  Côté patient

Nettoyage/désinfection

Utiliser uniquement les méthodes de désinfection et de nettoyage agréées qui sont exposées dans ces instructions :



Éliminer les tubulures et tous les composants du circuit après 20 cycles de nettoyage ou six mois après la première utilisation s'ils ont été nettoyés moins de 20 fois.
Ne pas dépasser les températures de nettoyage maximales recommandées.
Des températures de nettoyage trop élevées risquent d'endommager le circuit.
Ne pas utiliser de machine à laver/machine de nettoyage automatique car cela pourrait endommager le circuit.

Instructions pour le nettoyage et la désinfection :

Étape 1 – Nettoyage :



Attention : pour le nettoyage, porter un équipement de protection individuelle approprié, comme par exemple : gants jetables, visière anti-éclaboussures/lunettes de sécurité et blouse de protection.

- Démonter le circuit
REMARQUE : Nettoyer le circuit le plus rapidement possible après utilisation.
- Rincer les composants du circuit à l'eau chaude du robinet (<40 °C) immédiatement après utilisation.
- Remplir un évier ou un récipient d'eau chaude (<40 °C) et d'hypochlorite de sodium à une concentration maximale de 0,5%, puis faire tremper la tubulure et les composants pendant 30 à 40 minutes.
- Nettoyer l'intérieur de la tubulure en éliminant si nécessaire tous les débris visibles avec un écouvillon souple. Ne pas utiliser de brosse rigide à l'intérieur de la tubulure.
- Rincer abondamment l'intérieur et l'extérieur de la tubulure à l'eau chaude du robinet pour éliminer les résidus d'hypochlorite de sodium et les débris restants.
- Suspendre les tubulures en position verticale pour éliminer l'excès d'eau. Les tubulures peuvent sécher à l'air jusqu'à une température de 75 °C.



Avertissement : ne pas nettoyer ou sécher le circuit avec des solvants ou de l'alcool.

- Passer à l'étape 2, Désinfection de haut niveau.

Étape 2 – Désinfection de haut niveau :

Utiliser l'une des méthodes de désinfection proposées :

a. Désinfection à l'orthophthalaldéhyde (OPA) à 0,3% :



Attention : avant toute manipulation de l'OPA
Porter un équipement de protection individuelle approprié, comme par exemple : gants jetables, visière anti-éclaboussures/lunettes de sécurité et blouse de protection. Réaliser la désinfection dans une hotte de laboratoire ou avec un système d'aspiration des fumées. Lire les instructions du fabricant d'OPA avant utilisation.

- Remplir un évier/récipient d'OPA à 0,3%, par exemple Johnson and Johnson Cidex OPA (respecter les instructions du fabricant pour une préparation correcte de l'OPA).
Immerger totalement la tubulure et les composants dans le désinfectant.
Laisser tremper pendant au moins 30 minutes. Retirer ensuite toutes les pièces de l'OPA.
- Changez de gants.
- Rincer les tubulures et les composants à l'eau stérile (respecter les instructions du fabricant pour une procédure correcte de rinçage de l'OPA).
- Suspendre les tubulures verticalement pour les laisser sécher à l'air. Les tubulures peuvent sécher à l'air jusqu'à une température de 75 °C.
Inspecter la tubulure et les composants du circuit pour vérifier qu'ils ne sont pas fendus, déchirés ou endommagés.
Lorsque tous les composants sont secs, remonter le circuit respiratoire.
Placer le circuit dans un lieu propre et sec jusqu'à sa prochaine utilisation.

b. Désinfection par pasteurisation :

- Vérifier que le pasteurisateur est réglé entre 75 et 78 °C maximum.
REMARQUE : des températures supérieures à 78 °C endommageront la tubulure et en raccourciront la durée de vie.
Laisser les composants du circuit dans le pasteurisateur pendant une durée de 30 à 40 minutes.
- Sortir les composants du circuit et suspendre les tubulures verticalement pour les faire sécher. Les tubulures peuvent sécher à l'air jusqu'à une température de 75 °C.
Inspecter la tubulure et les composants du circuit pour vérifier qu'ils ne sont pas fendus, déchirés ou endommagés.
Lorsque tous les composants sont secs, remonter le circuit respiratoire.
Placer le circuit dans un lieu propre et sec jusqu'à sa prochaine utilisation.

c. Autoclave :



Avertissement : seuls les raccords du circuit peuvent être passés à l'autoclave. La tubulure sera détruite par un passage à l'autoclave.

- Vérifier que l'autoclave est réglé à une température de 121 °C ou de 136 °C.
Laisser les raccords du circuit dans l'autoclave pendant 30 minutes à 121 °C ou pendant 4 minutes à 136 °C.
Inspecter les raccords du circuit pour vérifier qu'ils ne sont pas fendus ou endommagés.
Lorsque tous les raccords sont secs, remonter les raccords du circuit sur la tubulure désinfectée.
Placer le circuit dans un lieu propre et sec jusqu'à sa prochaine utilisation.

Caractéristiques techniques :



Type BF

Connexions d'interface : ISO 5356-1 ou ISO 5367

Plage de température ambiante et plage de fonctionnement du gaz entrant : 18 °C – 26 °C

Température maximale fournie : <40 °C

	900MR810
Compliance :	4,6 mL/kPa/m
Volume compressible :	640 mL
Débit de fuite :	<25 mL/min @ 6 kPa
Résistance au débit nominal :	0,4 cmH ₂ O @ 60 ± 1 L/min
Plage de débit :	≥5 à ≤60 L/min *

* Testé avec la chambre MR370




Avertissement :

- Nettoyer le circuit avant utilisation et après chaque patient, en n'utilisant que les méthodes de désinfection agréées. L'utilisation de méthodes de nettoyage non agréées risque d'endommager le circuit et de réduire sa durée de vie utile.
- Le circuit doit être configuré et utilisé par un professionnel de santé qualifié.
- Inspecter le circuit avant toute réutilisation et ne pas le réutiliser s'il présente des signes de détérioration, par exemple s'il est fendu, déchiré ou endommagé.
- Utiliser exclusivement avec les chambres d'humidification et les accessoires Fisher & Paykel MR810.
- S'assurer que l'humidificateur est toujours placé plus bas que le patient.
- Ne pas remplir la chambre d'eau à une température supérieure à 37 °C.
- Paramétrer les alarmes appropriées du respirateur.
- Vérifier que le raccord portant le symbole patient se trouve sur le côté patient du circuit.
- Utiliser un piège à eau dans la branche expiratoire le cas échéant.
- Vérifier que tous les raccords de tubulure sont bien serrés avant utilisation.
- Effectuer un test de pression et de fuite sur le circuit respiratoire et vérifier la présence d'occlusions éventuelles avant de l'installer sur le patient.
- Vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble du circuit avec les paramètres de respirateur requis avant de l'installer le patient.
- Vérifier régulièrement l'absence de condensat dans la tubulure du circuit et les pièges à eau et drainer le cas échéant.
- Ne pas utiliser le circuit respiratoire chauffé sans débit de gaz. Si le débit de gaz est interrompu, éteindre l'humidificateur.
- Ne pas couvrir le circuit avec des couvertures, des serviettes ou des draps, par exemple.
- La température en surface peut atteindre 43 °C. Tout contact prolongé entre la tubulure du circuit et la peau du patient peut entraîner une ulcération ou une lésion cutanée.
- Ne pas écraser la tubulure du circuit.
- L'humidité sortant de ce système peut être affectée s'il est utilisé en dehors des plages de température ambiante ou de débit recommandées.
- Aucune modification de cet appareil n'est permise.
- Débrancher la tubulure uniquement en tenant les raccords d'extrémité : ne pas tirer ni tourner la tubulure car cela risquerait de l'endommager.
- Vérifier régulièrement le niveau d'eau dans la chambre d'humidification et rajouter de l'eau si nécessaire.
- Ne pas exposer les tubulures à un rayonnement UV excessif.
- Éliminer les tubulures et tous les éléments du circuit après 20 cycles de nettoyage ou six mois après la première utilisation s'ils ont été nettoyés moins de 20 fois. À la fin de la vie du produit, désinfecter le circuit puis l'éliminer comme déchet médical non contaminé.

Déclaration de garantie :

Fisher & Paykel Healthcare garantit que le circuit Evatherm™, s'il est utilisé conformément aux instructions d'utilisation, est exempt de tout défaut matériel et de fabrication et qu'il fonctionnera conformément aux caractéristiques de produit officielles publiées par Fisher & Paykel Healthcare pendant 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final. La présente garantie est sujette aux limites et exceptions exposées en détail sur <http://www.fphcare.com/evathermwarranty>

Deutsch  Siehe Benutzeranweisungen für MR810 Luftbefeuchter für weitere Informationen über die Einrichtung und den ordnungsgemäßen Gebrauch.

Verwendungszweck

Das 900MR810 Beatmungssystem für Erwachsene von Fisher & Paykel Healthcare ist zur gemeinsamen Verwendung mit dem MR810 Luftbefeuchter bestimmt, um für therapeutische Wärme- und Feuchtigkeitskonzentrationen in den Atemgasen des Patienten zu sorgen, wenn ein kontinuierliches oder ein intermittierendes Beatmungssystem oder ein System mit kontinuierlichem Gasfluss eingesetzt wird.

Die Zugabe von Wärme und Feuchtigkeit zu den kalten und trockenen Atemgasen, die dem Patienten bei der Beatmung zugeführt werden, sorgt dafür, dass die Atemwege des Patienten nicht austrocknen. Das MR810 System ist zur Verwendung in Krankenhäusern und Langzeitpflegeeinrichtungen sowie für den Gebrauch in häuslicher Umgebung gemäß der Verordnung einer qualifizierten medizinischen Fachkraft bestimmt.

Symbol:  Patientenseite

Reinigung/Desinfektion

Nur genehmigte Desinfektions- und Reinigungsmethoden verwenden, so wie in dieser Anweisung beschrieben:



Schläuche und sämtliche Komponenten des Schlauchsystems nach 20 Reinigungszyklen oder sechs Monate nach dem ersten Gebrauch entsorgen, je nachdem, was zuerst eintritt.
Maximal empfohlene Reinigungstemperatur nicht überschreiten, da erhöhte Reinigungstemperaturen das Schlauchsystem beschädigen können.
Keine automatisierten Wasch-/Reinigungssysteme verwenden, da diese das Schlauchsystem beschädigen können.

Anweisungen für die Reinigung und Desinfektion:

Schritt 1 – Reinigung:



Achtung: Während der Reinigung geeignete Schutzausrüstung tragen, z. B.: Einweghandschuhe, Klarvisier/Schutzbrille und Schutzkittel.

- Schlauchsystem zerlegen
HINWEIS: Schlauchsystem so schnell wie möglich nach dem Gebrauch reinigen.
 - Komponenten des Schlauchsystems direkt nach dem Gebrauch mit warmem Leitungswasser (<40 °C) abspülen.
 - In einem Waschbecken/Behälter mit warmem Wasser (<40 °C) und Natriumhypochlorit eine maximale 0,5%ige Lösung herstellen. Schlauchsystem und Komponenten 30–40 Minuten einweichen.
 - Sämtliche sichtbaren Verschmutzungen vom Innenbereich des Schlauchs entfernen und dazu eine weiche Flaschenbürste verwenden, sofern erforderlich. Keine harten Bürsten im Innenbereich des Schlauchs verwenden.
 - Innen- und Außenbereich des Schlauchs sorgfältig mit warmem Leitungswasser abspülen, um das restliche Natriumhypochlorit und Verschmutzungen zu entfernen.
 - Schläuche senkrecht aufhängen, damit überschüssiges Wasser abtropfen kann. Die Schläuche können bei bis zu 75 °C luftgetrocknet werden.
- Warnhinweis:** Trockenes Schlauchsystem nicht mit Lösungsmitteln oder Alkohol reinigen oder trocknen.
- Weiter mit hochwirksamer Desinfektion, Schritt 2.

Schritt 2 – Hochwirksame Desinfektion:

Eine der folgenden Desinfektionsmethoden verwenden:

a. Chemische Desinfektion mit 0,3 % Orthophthalaldehyd (OPA):



Achtung: Vor dem Gebrauch von OPA
Geeignete Schutzausrüstung tragen, z. B.: Einweghandschuhe, Klarvisier/Schutzbrille und Schutzkittel. Die Desinfektion muss in einem Desinfektionsschrank oder unter einer Abzugshaube erfolgen. Die Gebrauchsanweisung des OPA-Herstellers lesen.

- Waschbecken/Behälter mit 0,3%igem OPA-Desinfektionsmittel füllen, z. B. Johnson and Johnson OPA (Herstelleranweisungen zur ordnungsgemäßen Vorbereitung von OPA befolgen).
Herstellen und Komponenten vollständig in das Desinfektionsmittel eintauchen.
Mindestens 30 Minuten einweichen. Anschließend alle Teile aus dem OPA herausnehmen.
- Handschuhe wechseln.
- Schläuche und Komponenten mit sterilem Wasser abspülen (Herstelleranweisungen zum ordnungsgemäßen Abspülen von OPA befolgen).
- Schläuche senkrecht aufhängen, damit diese an der Luft trocknen können. Die Schläuche können bei bis zu 75 °C luftgetrocknet werden.
Schlauch und Komponenten des Schlauchsystems auf Brüche, Risse oder andere Schäden überprüfen. Wenn alle Komponenten trocken sind, Beatmungsschlauchsystem erneut zusammensetzen.
Schlauchsystem an einem trockenen und staubfreien Ort für den nächsten Gebrauch aufbewahren.

b. Desinfektion durch Pasteurisierung:

- Überprüfen, ob die Höchsttemperatur des Pasteurisiergeräts auf 75 bis 78 °C eingestellt ist.
HINWEIS: Temperaturen über 78 °C beschädigen den Beatmungsschlauch und verringern die Lebensdauer.
Komponenten des Beatmungssystems 30 bis 40 Minuten lang im Pasteurisiergerät lassen.
- Komponenten des Beatmungssystems herausnehmen und senkrecht zum Trocknen aufhängen.
Die Schläuche können bei bis zu 75 °C luftgetrocknet werden.
Schlauch und Komponenten des Schlauchsystems auf Brüche, Risse oder andere Schäden überprüfen. Wenn alle Komponenten trocken sind, Beatmungsschlauchsystem erneut zusammensetzen.
Schlauchsystem an einem trockenen und staubfreien Ort für den nächsten Gebrauch aufbewahren.

c. Autoklavierung:



Warnhinweis: Nur die Stecker des Schlauchsystems können autoklaviert werden. Autoklavieren führt zur Zerstörung der Schläuche.

- Überprüfen, ob der Autoklav entweder auf 121 °C oder 136 °C eingestellt ist.
Stecker des Schlauchsystems 30 Minuten bei 121 °C oder 4 Minuten bei 136 °C im Autoklav lassen.
Stecker des Schlauchsystems auf Brüche oder andere Beschädigungen überprüfen.
Wenn alle Stecker trocken sind, Stecker des Schlauchsystems wieder am desinfizierten Schlauchsystem anbringen.
Schlauchsystem an einem trockenen und staubfreien Ort für den nächsten Gebrauch aufbewahren.

Technische Daten:



Typ BF

Systemanschlüsse: ISO 5356-1 oder ISO 5367
Bereich für Umgebungslufttemperatur und Gaseinlass: 18 °C – 26 °C
Maximale Abgabetemperatur: <40 °C

	900MR810
Compliance:	4,6 mL/kPa/m
Komprimierbares Volumen:	640 mL
Leckgerate:	<25 mL/min bei 6 kPa
Flusswiderstand bei Nennfluss:	0,4 cmH ₂ O bei 60 ± 1 L/min
Flussbereich:	≥5 bis ≤60 L/min *

* Getestet mit MR370 Kammer



Warnhinweis:

- Schlauchsystem vor dem Gebrauch und nach jedem Patienteneinsatz reinigen und ausschließlich die genehmigten Desinfektionsmethoden anwenden. Die Anwendung von nicht genehmigten Reinigungsmethoden kann das Schlauchsystem beschädigen und dessen Lebensdauer verringern.
- Das System muss von einer qualifizierten medizinischen Fachkraft eingerichtet werden.
- Schlauchsystem vor der Wiederverwendung überprüfen und nicht verwenden, wenn am Schlauchsystem Abnutzungerscheinungen zu erkennen sind, wie z. B.: Brüche, Risse oder andere Beschädigungen.
- Nur mit Fisher & Paykel MR810 Befeuchterkammer und Zubehör verwenden.
- Darauf achten, dass sich der Luftbefeuchter immer auf einem niedrigeren Niveau als der Patient befindet.
- Die Kammer nicht mit Wasser füllen, das wärmer als 37 °C ist.
- Geeignete Beatmungsgerätealarme setzen.
- Darauf achten, dass sich der Anschluss mit dem Patientensymbol auf der Patientenseite des Schlauchsystems befindet.
- Wasserfalle auf der Expirationsseite verwenden, sofern zutreffend.
- Vor dem Gebrauch überprüfen, ob alle Schlauchanschlüsse dicht sind.
- Druck- und Leckageleak am Atmungssystem durchführen und auf Verstopfungen prüfen, bevor das Gerät an den Patienten angeschlossen wird.
- Überprüfen, ob das gesamte Schlauchsystem ordnungsgemäß funktioniert, einschließlich der erforderlichen Einstellungen des Beatmungsgeräts, bevor der Patient an das Gerät angeschlossen wird.
- Schlauchsystem und Wasserfallen regelmäßig auf Kondensation überprüfen und Kondensat ablassen, sofern erforderlich.
- Keine Beatmungsschlauchsysteme mit Heizdraht ohne Gasflow verwenden. Bei Unterbrechung des Gasflows den Luftbefeuchter ausschalten.
- Das Schlauchsystem nicht mit Gegenständen, wie Decken, Handtüchern oder Bettüchern bedecken.
- Die Oberflächentemperatur kann 43 °C erreichen. Bei längerem Kontakt zwischen den Schläuchen und der Haut des Patienten kann es zu Druck- oder Hautverletzungen kommen.
- Schläuche nicht quetschen.
- Die Feuchtigkeitsabgabe des Systems kann beeinträchtigt werden, wenn das System außerhalb der empfohlenen Umgebungstemperatur oder Flussbereichs eingesetzt wird.
- An diesem Gerät sind keinerlei Änderungen zulässig.
- Schläuche nur durch Greifen der Anschlüsse trennen, nicht an den Schläuchen ziehen oder diese drehen, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Wasserstand in der Befeuchterkammer regelmäßig überprüfen und auffüllen, sofern erforderlich.
- Schläuche nicht übermäßiger UV-Strahlung aussetzen.
- Schläuche und sämtliche Komponenten des Schlauchsystems nach 20 Reinigungszyklen oder sechs Monate nach dem ersten Gebrauch entsorgen, je nachdem, was zuerst eintritt. Am Ende der Lebensdauer des Produkts das Schlauchsystem desinfizieren und anschließend als nicht kontaminierten medizinischen Abfall entsorgen.

Garantieerklärung:

Fisher & Paykel Healthcare garantiert, dass das Evatherm™-Schlauchsystem, sofern dies gemäß der Gebrauchsanweisung verwendet wird, frei von Herstellungs- und Materialfehlern ist und gemäß den offiziellen, von Fisher & Paykel Healthcare veröffentlichten Produktspezifikationen 90 Tage lang ab Kaufdatum vom Endbenutzer eingesetzt werden kann. Diese Garantie unterliegt den Einschränkungen und Ausnahmen, die hier detailliert aufgeführt sind: <http://www.fphcare.com/evathermwarranty>



Raadpleeg de gebruikersinstructies bij de MR810-bevochtiger voor meer informatie over installeren en juist gebruik van het apparaat.

Beoogd gebruik

Het Fisher & Paykel Healthcare 900MR810-beademingscircuit voor volwassenen is bedoeld voor gebruik met de MR810-bevochtiger om de ingeademde beademingslucht van patiënten vochtig en warm te houden op een bepaald therapeutisch niveau, bij gebruik van een constant of intermitterend beademingsstelsysteem.

Het toevoegen van warmte en vocht aan de aanvoer van koude en droge beademingslucht door middel van beademing voorkomt het uitdrogen van de luchtwegen van patiënten. Het MR810-systeem is bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen, instellingen voor langdurige zorg en voor thuisgebruik voorgeschreven door een medisch professional.

Symbool:  **Patiëntkant**

Reiniging/desinfectie

Gebruik uitsluitend de in deze instructies beschreven goedgekeurde methoden voor reiniging en desinfectie:



Gooi na 20 reinigingscycli of zes maanden na het eerste gebruik (wat zich het eerste voordoet) de slangen en alle circuitcomponenten weg.
Overschrijd de aanbevolen maximumtemperaturen voor reiniging niet; hogere reinigingstemperaturen kunnen tot beschadiging van het circuit leiden.
Gebruik geen automatisch wasapparaat; hierin kan het circuit beschadigd raken.

Instructies voor reiniging en desinfectie:

Stap 1 – Reiniging:



Voorzichtig: Draag tijdens het reinigen geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals: wegwerphandschoenen, beschermingsvizier/veiligheidsbril en beschermjas.

- Demonteer het circuit
NB: Reinig het circuit zo snel mogelijk na gebruik.
- Spoel de circuitcomponenten direct na gebruik met warm kraanwater (<40 °C).
- Vul een (spoe)bak met warm water (<40 °C) en voeg zoveel natriumhypochloriet toe dat u een oplossing met een concentratie van maximaal 0,5% krijgt. Leg de slangen en componenten in deze oplossing en laat deze 30–40 minuten hierin liggen.
- Reinig de binnenzijde van de slangen. Zorg dat u alle zichtbare vuil verwijdert, zo nodig met een zachte flessenborstel. Gebruik geen harde borstel voor het reinigen van de binnenzijde van de slangen.
- Spoel de binnen- en buitenzijde van de slangen grondig met warm kraanwater om achtergebleven natriumhypochloriet en vuil te verwijderen.
- Hang de slangen verticaal op om overtollig water te verwijderen. Slangen kunnen aan de lucht worden gedroogd bij een temperatuur tot 75 °C.



Waarschuwing: Reinig of droog het circuit niet met oplosmiddelen of alcohol.

- Ga verder naar hoogwaardige desinfectie, stap 2.

Stap 2 – Hoogwaardige desinfectie:

Gebruik een van de weergegeven desinfectiemethoden:

a. Desinfectie met 0,3% orthoformaldehyde (OPA), chemisch:



Voorzichtig: voordat u OPA hanteert
Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals: wegwerphandschoenen, beschermingsvizier/ veiligheidsbril en beschermjas. Voer de desinfectie uit in een zuurkast of in een ruimte met rookgasafzuiging. Lees de door de fabrikant verstrekte aanwijzingen voor het gebruik.

- Vul een (spoe)bak met 0,3% OPA-desinfectiemiddel, zoals Cidex OPA van Johnson and Johnson (volg de instructies van de fabrikant voor de juiste bereiding van OPA).
Dompel de slang en de componenten volledig onder in het desinfectiemiddel.
Laat de onderdelen minimaal 30 minuten hierin liggen. Neem vervolgens alle onderdelen uit de OPA.
- Wissel de handschoenen.
- Spoel de slangen en componenten met steriel water (volg de instructies van de fabrikant voor de juiste procedure voor het afspoelen van OPA).
- Hang de slangen verticaal op om deze aan de lucht te laten drogen. Slangen kunnen aan de lucht worden gedroogd bij een temperatuur tot 75 °C.
Controleer de slangen en circuitcomponenten op barsten, scheuren en andere beschadigingen. Wanneer alle componenten droog zijn, zet u het beademingscircuit weer in elkaar. Sla het circuit voor een volgend gebruik op in een droge en stofvrije omgeving.

b. Desinfectie door middel van pasteurisatie:

- Stel het pasteurisatieapparaat in op een temperatuur tussen 75 en 78 °C.
NB: Temperaturen hoger dan 78 °C leiden tot beschadiging van de beademingslang en verkorten de levensduur ervan.
Laat circuitcomponenten 30 tot 40 minuten in het pasteurisatieapparaat liggen.
- Neem de circuitcomponenten eruit en hang de slangen verticaal op om te drogen.
Slangen kunnen aan de lucht worden gedroogd bij een temperatuur tot 75 °C.
Controleer de slangen en circuitcomponenten op barsten, scheuren en andere beschadigingen. Wanneer alle componenten droog zijn, zet u het beademingscircuit weer in elkaar. Sla het circuit voor een volgend gebruik op in een droge en stofvrije omgeving.

c. In de autoclaaf:



Waarschuwing: Alleen de connectors van het circuit kunnen in de autoclaaf worden gedesinfecteerd. Autoclaven is funest voor de slangen.

- Stel de autoclaaf in op 121 °C of 136 °C.
Laat de circuitconnectors 30 minuten in de autoclaaf liggen bij 121 °C of 4 minuten bij 136 °C.
Controleer de circuitconnectors op barsten en andere beschadigingen. Wanneer alle connectors droog zijn, monteert u de circuitconnectors weer op de gedesinfecteerde slangen. Sla het circuit voor een volgend gebruik op in een droge en stofvrije omgeving.

Technische specificaties:



Type BF

Maskeraansluitingen: ISO 5356-1 of ISO 5367

Omgevingstemperatuurbereik en bedrijfsbereik van inlaatgas: 18 °C – 26 °C

Maximumtemperatuur van toegeleid gas: <40 °C

	900MR810
Compliance:	4,6 mL/kPa/m
Samendrukbaar volume:	640 mL
Lekkagesnelheid:	<25 mL/min bij 6 kPa
Flowweerstand bij nominale flow:	0,4 cmH ₂ O bij 60 ± 1 L/min
Flowbereik:	≥5 tot ≤60 L/min *

* Getest met MR370-kamer



Waarschuwing:

- Reinig het circuit vóór gebruik en na het gebruik bij elke patiënt en uitsluitend volgens goedgekeurde desinfectiemethoden. Bij gebruik van niet-goedgekeurde reinigingsmethoden kan het circuit beschadigd raken met een kortere bruikbare levensduur tot gevolg.
- Moet worden geïnstalleerd en gebruikt door bekwaame medische professionals.
- Controleer het circuit voordat u het weer in gebruik neemt. Gebruik het niet als het tekenen van achteruitgang vertoont zoals: barsten, scheuren of andere beschadigingen.
- Alleen voor gebruik met Fisher & PaykelMR810-bevochtigingskamers en -accessoires.
- Zorg dat de bevochtiger zich altijd op een lager niveau bevindt dan de patiënt.
- Vul de kamer niet met water warmer dan 37 °C.
- Stel de juiste alarmen van het beademingsstelsysteem in.
- Zorg dat de connector met het patiëntensymbool zich aan de patiëntkant van het circuit bevindt.
- Voorzie indien van toepassing de uitademingslang van een wateropvangervanger.
- Controleer vóór gebruik of alle slangverbindingen goed vastzitten.
- Voer een druk- en lekkagetest uit bij het beademingsstelsysteem en controleer op afsluitingen alvorens het systeem aan te sluiten op een patiënt.
- Verzeker u ervan dat het gehele circuit goed werkt bij de vereiste instellingen van het beademingsstelsysteem alvorens u het circuit op een patiënt aansluit.
- Controleer de circuitslang en de wateropvangervanger regelmatig op condensaat en voer dit indien nodig af.
- Gebruik het verwarmde beademingscircuit alleen als er gas stroomt. Zet de bevochtiger uit als de gasflow wordt onderbroken.
- Bedenk het circuit niet met materialen zoals dekens, handdoeken of beddengoed.
- De oppervlaktetemperatuur kan oplopen tot 43 °C. Langdurig contact tussen de circuitslang en blootliggende huid van de patiënt kan resulteren in drukletsel of huidbeschadiging.
- De circuitslang niet pletten.
- De vochtproductie van dit systeem kan worden aangetast als het buiten het omgevingstemperatuurbereik of flowbereik wordt gebruikt.
- Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan deze apparatuur.
- De koppeling van slangen alleen los door de eindconnectors uit elkaar te halen. Trek niet aan de slangen en verdraai deze niet, omdat dit beschadigingen kan veroorzaken.
- Controleer het waterniveau in de bevochtigingskamer regelmatig en vul het indien nodig bij.
- De slangen niet blootstellen aan overmatige UV-straling.
- Gooi na 20 reinigingscycli of zes maanden na het eerste gebruik (wat zich het eerste voordoet) de slangen en alle circuitcomponenten weg. Aan het einde van de levensduur van het product desinfecteert u het circuit en gooit u het weg als niet-besmet medisch afval.

Garantieverklaring:

Fisher & Paykel Healthcare geeft gedurende een periode van 90 dagen vanaf de datum van aankoop door de eindgebruiker de garantie dat het Evatherm™ circuit, wanneer gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing, vrij is van fabricage- en materiaalfouten en zal functioneren overeenkomstig de officiële productspecificaties van Fisher & Paykel. Op deze garantie zijn de beperkingen en uitzonderingen van toepassing die u uitgebreid kunt raadplegen op: <http://www.fphcare.com/evathermwarranty>



Consulte las instrucciones para el usuario del humidificador MR810 para más información sobre la configuración y el uso correctos.

Uso previsto

Los circuitos respiratorios para adultos 900MR810 de Fisher & Paykel Healthcare están diseñados para utilizarse junto con el humidificador MR810 para administrar niveles terapéuticos de calor y humedad a los gases respiratorios inspirados por un paciente cuando se utiliza un sistema de ventilación continua o intermitente o un sistema de flujo de gas continuo.

La adición de calor y humedad al suministro de gases respiratorios fríos y secos administrados mediante ventilación resulta beneficiosa para prevenir la sequedad de las vías respiratorias del paciente. El sistema MR810 está diseñado para su uso en hospitales, centros de atención a largo plazo y hogares bajo la prescripción de un profesional médico cualificado.

Símbolo:  **Extremo del paciente**

Limpeza/Desinfección

Utilice solo los métodos de desinfección y limpieza aprobados que se indican en estas instrucciones:



Deseche los tubos y todos los componentes de los circuitos después de 20 ciclos de limpieza, o seis meses después del primer uso, lo que ocurra antes.
No supere las temperaturas de limpieza máximas recomendadas, ya que estas podrían dañar el circuito.
No use una lavadora/limpiadora automática, ya que podrían dañar el circuito.

Instrucciones de limpieza y desinfección:

Paso 1 – Limpieza:



Precaución: al limpiar, utilice equipos de protección personal adecuados, como guantes desechables, visor antisalpicaduras/gafas de seguridad y bata protectora.

- Desmonte el circuito
NOTA: limpie el circuito lo antes posible después de usarlo.
- Enjuague los componentes del circuito después del uso con agua caliente del grifo (<40 °C).
- Llene un fregadero/recipiente con agua caliente (<40 °C) e hipoclorito de sodio al 0,5% a la máxima concentración. A continuación, sumerja los tubos y componentes durante 30–40 minutos.
- Limpie la parte interna del tubo, eliminando todos los residuos visibles con un cepillo limpiabotellas suave si fuera necesario. No utilice cepillos duros dentro del tubo.
- Enjuague el interior y el exterior del tubo con agua caliente del grifo para eliminar el hipoclorito de sodio y los residuos que pudieran quedar.
- Cuelgue los tubos verticalmente para eliminar el exceso de agua. Los tubos se pueden secar al aire a una temperatura de hasta 75 °C.



Advertencia: no limpie ni seque los componentes con disolventes o alcohol.

- Continúe con la desinfección de alto nivel, paso 2.

Paso 2 – Desinfección de alto nivel:

Utilice uno de los métodos de desinfección indicados:

a. Desinfección con el producto químico ortoformaldehído (OPA) al 0,3%:



Precaución: antes de manipular el OPA
Utilice materiales de protección personal adecuados, como guantes desechables, visor antisalpicaduras/gafas de seguridad y bata protectora. Asegúrese de que realice la desinfección debajo de una vitrina o campana extractora. Lea las instrucciones de uso del fabricante del OPA.

- Llene un fregadero/recipiente con OPA desinfectante al 0,3%, como Cidex OPA de Johnson and Johnson (consulte en las instrucciones del fabricante la correcta preparación del OPA).
Sumerja por completo el tubo y los componentes en desinfectante.
Sumerja durante al menos 30 minutos. A continuación, saque todas las piezas del OPA.
- Cámbiese de guantes.
- Enjuague los tubos y componentes con agua estéril (siga las instrucciones del fabricante respecto al procedimiento de enjuague correcto del OPA).
- Cuelgue los tubos verticalmente para que se sequen al aire. Los tubos se pueden secar al aire a una temperatura de hasta 75 °C.
Inspeccione el tubo y los componentes del circuito para ver si presentan fisuras, desgaste o daños. Una vez secos todos los componentes, vuelva a montar el circuito de respiración. Guarde el circuito en un lugar seco y sin polvo y preparado para el uso siguiente.

b. Desinfección y pasteurización:

- Asegúrese de que el pasteurizador esté entre 75 y 78 °C como máximo.
NOTA: temperaturas superiores a 78 °C dañarán el tubo de respiración y acortarán su vida útil.
Deje los componentes del circuito en el pasteurizador entre 30 y 40 minutos.
- Saque los componentes del circuito y cuelgue los tubos en vertical para que se sequen. Los tubos se pueden secar al aire a una temperatura de hasta 75 °C.
Inspeccione el tubo y los componentes del circuito para ver si presentan fisuras, desgaste o daños. Una vez secos todos los componentes, vuelva a montar el circuito de respiración. Guarde el circuito en un lugar seco y sin polvo y preparado para el uso siguiente.

c. Autoclave:



Advertencia: solo se pueden esterilizar con autoclave los conectores del circuito. El procedimiento de autoclave destruirá los tubos.

- Compruebe que el autoclave esté ajustado a 121 °C o a 136 °C.
Deje los conectores del circuito en el autoclave durante 30 minutos a 121 °C o 4 minutos a 136 °C.
Inspeccione el tubo y los componentes del circuito para ver si presentan fisuras o daños. Una vez secos todos los conectores, vuelva a montar los conectores del circuito al tubo desinfectado. Guarde el circuito en un lugar seco y sin polvo y preparado para el uso siguiente.

Especificaciones técnicas:



Tipo BF

Conexiones de interfaz: ISO 5356-1 o ISO 5367

Intervalo operativo de temperatura ambiente y de la entrada del gas: 18 °C – 26 °C

Máxima temperatura suministrada: <40 °C

	900MR810
Distensibilidad:	4,6 mL/kPa/m
Volumen comprimible:	640 mL
Tasa de fuga:	<25 mL/min a 6 kpa
Resistencia al flujo a flujo nominal:	0,4 cmH ₂ O a 60 ± 1 L/min
Caudales:	≥5 a ≤60 L/min *

* Analizado con la cámara MR370



Advertencia:

- Limpie el circuito antes de su utilización y después de usarlo en cada paciente usando únicamente los métodos de desinfección aprobados. El uso de métodos de limpieza no aprobados pueden dañar el circuito reducir su vida útil.
- Debe ser configurado y usado por un profesional médico con la formación adecuada.
- Inspeccione el circuito antes de volver a utilizarlo y no lo use si muestra signos de deterioro como: grietas, desgastes o daños.
- Utilícelo solo con cámaras de humidificación y accesorios Fisher & Paykel MR810.
- Compruebe que el humidificador esté siempre colocado en una posición más baja que el paciente.
- No llene la cámara con agua a más de 37 °C de temperatura.
- Configure las alarmas correctas en los ventiladores.
- Compruebe que el conector con el símbolo del paciente se encuentre en el extremo del paciente del circuito.
- Use una trampa de agua en el ramal espiratorio cuando proceda.
- Compruebe que todas las conexiones de los tubos estén bien apretadas antes de usarlo.
- Realice una prueba de presión y fugas en el sistema respiratorio y verifique que no se han producido oclusiones antes de conectar el dispositivo a un paciente.
- Asegúrese de que el circuito completo funciona correctamente con los ajustes requeridos del ventilador antes de conectarlo a un paciente.
- Compruebe la condensación en los tubos del circuito y las trampas de agua y drene cuando sea necesario.
- No utilice el circuito respiratorio calentado sin flujo de gas. Si el flujo de gas se interrumpe, desconecte el humidificador.
- No cubra el circuito con elementos como mantas, toallas o ropa de cama.
- La temperatura de la superficie puede alcanzar los 43 °C. Un contacto prolongado del tubo del circuito con la piel del paciente puede provocar lesiones por presión o daños en la piel.
- No aplaste el tubo del circuito.
- La producción de humedad de este sistema puede verse comprometida si se utiliza con intervalos de temperatura o flujos distintos a los recomendados.
- No se permite realizar ninguna modificación en este equipo.
- Desconecte el tubo solo manipulando los conectores de los extremos, no tire de los tubos ni los retuerza, ya que podría causar daños.
- Compruebe el nivel del agua de la cámara de humidificación regularmente y relénela cuando sea necesario.
- No exponga los tubos a una radiación UV excesiva.
- Deseche los tubos y todos los componentes de los circuitos después de 20 ciclos de limpieza, o seis meses después del primer uso, lo que ocurra antes. Al final de la vida útil del producto, desinfecte el circuito y deseche como residuo médico no contaminado.

Declaración de garantía:

Fisher & Paykel Healthcare garantiza que el circuito Evatherm™ si se usa de acuerdo a las instrucciones de uso, estará libre de defectos de mano de obra y materiales y se comportará de acuerdo con las especificaciones oficiales publicadas del producto de Fisher & Paykel Healthcare durante un periodo de 90 días a partir de la fecha de compra por parte del usuario final. Esta garantía está sujeta a limitaciones y excepciones establecidas en detalle en la siguiente página web <http://www.fphcare.com/evathermwarranty>



Per ulteriori informazioni sulla configurazione ed il corretto utilizzo di questo dispositivo, fare riferimento alle istruzioni per l'utente dell'umidificatore MR810.

Uso previsto

Il circuito respiratorio per adulti Fisher & Paykel Healthcare 900MR810 deve essere utilizzato con l'umidificatore MR810 al fine di fornire livelli terapeutici di calore e umidità ai gas respiratori ispirati da un paziente quando viene utilizzato un sistema di ventilazione continua o intermittente o un sistema a flusso costante di gas.

L'aggiunta di calore e umidità al gas respiratori erogati mediante la ventilazione, freddi e secchi, ha un effetto benefico, poiché consente di evitare la secchezza delle vie respiratorie del paziente. Il sistema MR810 deve essere utilizzato in strutture ospedaliere e di lungodegenza e case di cura dietro prescrizione di un medico qualificato.

Simbolo:  **estremità paziente**

Pulizia/disinfezione

Utilizzare soltanto i metodi di disinfezione e di pulizia approvati menzionati in queste istruzioni:



gettare i tubi e tutti i componenti del circuito dopo 20 cicli di pulizia o dopo sei mesi dal primo utilizzo, secondo quale delle due condizioni si verifica per prima;
non superare le massime temperature di pulizia raccomandate, poiché temperature più elevate potrebbero danneggiare il circuito;
non utilizzare mezzi di lavaggio o pulitori automatici, poiché potrebbero danneggiare il circuito.

Istruzioni di pulizia e disinfezione:

Fase 1 – Pulizia



Attenzione: durante la pulizia, indossare idonei dispositivi di protezione individuale, come guanti monouso, visiera di protezione dagli schizzi/occhiali di sicurezza e camice protettivo.

- Disassemblare il circuito
NOTA: dopo l'utilizzo, pulire il circuito al più presto.
- Subito dopo l'utilizzo, risciacquare i componenti del circuito con acqua tiepida di rubinetto (<40 °C).
- Riempire un lavabo/contenitore con acqua tiepida (<40 °C) ed ipoclorito di sodio ad una concentrazione massima dello 0,5%. Poi immergervi i tubi e i componenti per 30–40 minuti.
- Pulire la parte interna dei tubi, eliminando tutti i residui visibili con uno scovolino morbido, se necessario. All'interno del tubo non utilizzare spazzolini duri.
- Risciacquare accuratamente la parte interna ed esterna del tubo con acqua tiepida di rubinetto per eliminare l'ipoclorito di sodio ed i residui rimanenti.
- Appendere i tubi in posizione verticale per eliminare l'acqua in eccesso. È possibile asciugare i tubi fino a una temperatura di 75 °C.



Avvertenza: non pulire o asciugare il circuito con solventi o alcool.

- Procedere alla fase 2, disinfezione di alto livello.

Fase 2 – Disinfezione di alto livello

Utilizzare uno dei metodi di disinfezione mostrati:

a. disinfezione con ortoformaldeide 0,3% (OPA)



Attenzione: prima di maneggiare l'OPA
Indossare idonei dispositivi di protezione individuale, come guanti monouso, visiera di protezione dagli schizzi/occhiali di sicurezza e camice protettivo. Accertarsi che la disinfezione sia eseguita in una cappa aspirante o con estrazione dei fumi. Leggere le istruzioni per l'uso dei produttori di OPA.

- Riempire un lavabo/contenitore con un disinfettante OPA 0,3% come Cidex OPA di Johnson and Johnson (seguire le istruzioni del produttore per la corretta preparazione dell'OPA).
Immergere completamente il tubo e i componenti nel disinfettante.
Tenervi in immersione per almeno 30 minuti. Quindi estrarre tutte le parti dall'OPA.
- Cambiare i guanti.
- Risciacquare i tubi e i componenti con acqua sterile (seguire le istruzioni del produttore sulla corretta procedura di risciacquo dell'OPA).
- Far asciugare i tubi appendendoli in posizione verticale. È possibile asciugare i tubi con una temperatura fino a 75 °C.
Esaminare il tubo ed i componenti del circuito per individuare incrinature, rotture o danni. Quando tutti i componenti sono asciutti, rimontare il circuito respiratorio. Conservare il circuito in un ambiente asciutto e senza polvere, pronto per l'utilizzo successivo.

b. disinfezione mediante pastorizzazione

- Accertarsi che il pastorizzatore sia impostato in modo da mantenere la temperatura tra 75 ed un massimo di 78 °C.
NOTA: temperature superiori a 78 °C danneggerebbero il tubo respiratorio e ne diminuirebbero la durata.

- Tenere i componenti del circuito nel pastorizzatore tra 30 e 40 minuti.
- Estrarre i componenti del circuito e far asciugare i tubi in posizione verticale. È possibile asciugare i tubi fino a una temperatura di 75 °C.
Esaminare il tubo ed i componenti del circuito per individuare incrinature, rotture o danni. Quando tutti i componenti sono asciutti, rimontare il circuito respiratorio. Conservare il circuito in un ambiente asciutto e senza polvere, pronto per l'utilizzo successivo.

c. sterilizzazione in autoclave



Avvertenza: è possibile sterilizzare in autoclave soltanto i connettori del circuito. Sterilizzare in autoclave i tubi li rovinerebbe.

- Verificare che l'autoclave sia impostato su 121 °C o 136 °C.
Lasciare nell'autoclave i connettori del circuito per 30 minuti a 121 °C o per 4 minuti a 136 °C.
Esaminare i connettori del circuito per individuare incrinature o danni. Quando tutti i connettori sono asciutti, rimontare i connettori del circuito per disinfectare i tubi. Conservare il circuito in un ambiente asciutto e senza polvere, pronto per l'utilizzo successivo.

Specifiche tecniche:



Tipo BF

Collegamenti interfaccia: ISO 5356-1 o ISO 5367

Temperatura ambiente ed intervallo operativo dei gas in entrata: 18 °C – 26 °C

Temperatura di erogazione massima: <40 °C

	900MR810
Compliance:	4,6 mL/kPa/m
Volume comprimibile:	640 mL
Velocità di perdita:	<25 mL/min a 6 kpa
Resistenza al flusso alla portata nominale:	0,4 cmH ₂ O a 60 ± 1 L/min
Intervallo di flusso:	≥ 5 a ≤60 L/min *

* Testato con la camera MR370



Avvertenza:

- Pulire il circuito prima dell'uso e dopo l'utilizzo su ciascun paziente, utilizzando solo i metodi di disinfezione approvati. L'utilizzo di metodi di pulizia non approvati potrebbe danneggiare il circuito e ridurre la vita utile.
- Questo dispositivo deve essere impostato ed utilizzato da un medico qualificato.
- Esaminare il circuito prima di riutilizzarlo e non usarlo se presenta segni di deterioramento, come incrinature, rotture o danni.
- Utilizzare questo dispositivo soltanto con le camere di umidificazione e gli accessori Fisher & Paykel MR810.
- Accertarsi che l'umidificatore sia sempre posizionato più in basso rispetto al paziente.
- Non riempire la camera con acqua ad una temperatura superiore a 37 °C.
- Impostare allarmi ventilatore adeguati.
- Verificare che il connettore con il simbolo del paziente sia posizionato all'estremità del circuito dalla parte del paziente.
-



Consulte as instruções de utilização do umidificador MR810 para obter mais informações sobre montagem e utilização adequadas.

Indicações de uso

O circuito respiratório para adultos 900MR810 da Fisher & Paykel Healthcare é projetado para uso com umidificador MR810 a fim de proporcionar níveis terapêuticos de calor e de umidade aos gases respiratórios inspirados pelo paciente quando um sistema de ventilação contínua ou intermitente ou um sistema de fluxo contínuo de gás é usado.

A adição de calor e de umidade ao suprimento de gases respiratórios frios e secos fornecido por ventilação é benéfica para impedir o ressecamento das vias aéreas do paciente. O sistema MR810 é projetado para uso em hospitais, casas e centros de cuidados de longo prazo sob a prescrição de um profissional de saúde qualificado.

Símbolo:



Extremidade do paciente

Limpeza/Desinfecção

Utilize apenas métodos de desinfecção e limpeza aprovados conforme especificado nestas instruções:



Descarte as cânulas e todos os componentes do circuito após 20 ciclos de limpeza ou seis meses após a primeira utilização, o que ocorrer primeiro. Não ultrapasse as temperaturas de limpeza máximas recomendadas, pois temperaturas de limpeza mais altas podem danificar o circuito. Não utilize lavadores/limpadores automatizados, pois podem danificar o circuito.

Instruções de limpeza e desinfecção:

Passo 1 – Limpeza:



Atenção: Ao limpar, use equipamento de proteção individual adequado, como: luvas descartáveis, protetor facial com viseira/óculos de segurança e avental de proteção.

- Desmonte o circuito

NOTA: Limpe o circuito o mais rápido possível após a utilização.
- Enxágue os componentes do circuito logo após a utilização com água morna corrente (<40 °C).
- Encha uma pia/recipiente com água morna (<40 °C) e hipoclorito de sódio até a concentração máxima de 0,5%. Em seguida, deixe o circuito e os componentes de molho por 30–40 minutos.
- Limpe a parte interna da cânula, removendo toda a sujeira visível, se necessário, com uma escova lava-garrafa macia. Não utilize escovas duras dentro da cânula.
- Enxágue bem a parte interna e externa da cânula com água morna corrente para remover o hipoclorito de sódio e a sujeira restantes.
- Pendure as cânulas verticalmente para remover o excesso de água. A secagem ao ar livre das cânulas pode ser a até 75 °C.



Advertência: Não limpe ou seque o circuito com solventes ou álcool.

- Proceda para a desinfecção de alto nível, o passo 2.

Passo 2 – Desinfecção de alto nível:

Utilize um dos métodos de desinfecção mostrados abaixo:

a. Desinfecção com 0,3% da substância orto-ftalaldeído (OPA):



Atenção: Antes de manusear o OPA Use equipamentos de proteção individual adequados, como: luvas descartáveis, protetor facial com viseira/óculos de segurança e avental de proteção. Não deixe de realizar a desinfecção em uma câmara de fluxo laminar ou com extração de vapores. Leia as instruções de utilização do fabricante do OPA.

- Encha a pia/recipiente com desinfetante OPA a 0,3%, o Johnson & Johnson Cidex OPA (siga as instruções do fabricante sobre a preparação correta do OPA). Mergulhe a cânula e os componentes completamente no desinfetante. Deixe de molho por no mínimo 30 minutos. Em seguida, retire todas as peças do OPA.
- Troque de luvas.
- Enxágue as cânulas e os componentes em água estéril (siga as instruções do fabricante sobre o método correto de enxágue do OPA).
- Pendure as cânulas verticalmente para secarem ao ar livre. A secagem ao ar livre das cânulas pode ser a até 75 °C. Inspeccione a cânula e os componentes do circuito, verifique se há rachaduras, rasgos ou deterioração. Quando todos os componentes estiverem secos, monte novamente o circuito respiratório. Armazene o circuito em ambiente seco e livre de poeira, pronto para a próxima utilização.

b. Desinfecção por Pasteurização:

- Confira se o pasteurizador está regulado para funcionar entre 75 e 78 °C, no máximo.

NOTA: Temperaturas acima de 78 °C danificam o circuito respiratório e reduzem sua vida útil.
- Deixe os componentes do circuito no pasteurizador por 30 a 40 minutos.

Retire os componentes do circuito e pendure a cânula verticalmente para secar. A secagem ao ar livre das cânulas pode ser a até 75 °C. Inspeccione a cânula e os componentes do circuito, verifique se há rachaduras, rasgos ou deterioração. Quando todos os componentes estiverem secos, monte novamente o circuito respiratório. Armazene o circuito em ambiente seco e livre de poeira, pronto para a próxima utilização.

c. Autoclave:



Advertência: Apenas os conectores do circuito podem ser autoclavados. Autoclavar destrói as cânulas.

- Certifique-se de que a autoclave esteja ajustada para 121 °C ou 136 °C.

Deixe os conectores do circuito em autoclave por 30 minutos a 121 °C ou por 4 minutos a 136 °C. Inspeccione os conectores do circuito, verifique se há quaisquer rachaduras ou deterioração. Quando todos os conectores estiverem secos, monte novamente os conectores do circuito no circuito desinfetado. Armazene o circuito em ambiente seco e livre de poeira, pronto para a próxima utilização.

Especificações Técnicas:



Tipo BF

Conexões de interface: ISO 5356-1 ou ISO 5367

Variação da temperatura ambiente e variação de operação da entrada de gás: 18 °C – 26 °C

Temperatura máxima fornecida:<40 °C

	900MR810
Conformidade:	4,6 mL/kPa/m
Volume compressível:	640 mL
Taxa de vazão:	<25 mL/min @ 6 kpa
Resistência ao fluxo no fluxo nominal:	0,4 cmH ₂ O @ 60 ± 1 L/min
Variação de fluxo:	≥5 a ≤60 L/min *

* Testado com câmara MR370



Advertência:

- Limpe o circuito antes de usar e após cada utilização pelo paciente, usando apenas métodos de desinfecção aprovados.O emprego de métodos de limpeza não aprovados pode danificar o circuito e reduzir sua vida útil.
- Deve ser montado e utilizado por profissionais médicos treinados.
- Inspeccione o circuito antes de reutilizar, não use caso o circuito mostre sinais de deterioração, como: rachaduras, rasgos ou avarias.
- Utilizar apenas com câmaras de umidificação e acessórios Fisher & Paykel MR810.
- Certifique-se de que o umidificador esteja sempre posicionado em local mais baixo que o paciente.
- Não encha a câmara com água a mais que 37 °C.
- Configure os alarmes do ventilador adequadamente.
- Certifique-se de que o conector com o símbolo do paciente está localizado na extremidade do paciente.
- Use um coletor de água no ramo expiratório quando aplicável.
- Verifique se todas as conexões do circuito estão firmemente encaixadas antes de utilizar.
- Realize um teste de vazamento e pressão no sistema respiratório e verifique se há oclusões antes de conectar a um paciente.
- Verifique todas as funções do circuito corretamente de acordo com as configurações do ventilador antes de conectar ao paciente.
- Verifique o circuito e o coletor de água regularmente quanto à condensação, e drene conforme necessário.
- Não utilize o circuito respiratório aquecido sem fluxo de gás. Se o fluxo de gás for interrompido, desligue o umidificador.
- Não cubra o circuito com materiais como cobertores, toalhas ou lençóis.
- A temperatura da superfície pode chegar a 43 °C. O contato prolongado do circuito com a pele exposta do paciente pode resultar em ulcera por pressão ou em danos à pele.
- Não esprema o circuito.
- A produção de umidade deste sistema pode ser comprometida se for usado fora da temperatura ambiente ou da variação de fluxo recomendadas.
- Não é permitida nenhuma modificação a este equipamento.
- Desconecte a cânula manuseando apenas os conectores das extremidades; não puxe ou torça a cânula, pois poderá danificá-la.
- Confira o nível de água na câmara de umidificação regularmente e complete conforme a necessidade.
- Não exponha as cânulas à radiação UV excessiva.
- Descarte as cânulas e todos os componentes do circuito após 20 ciclos de limpeza ou seis meses após a primeira utilização, o que ocorrer primeiro. Ao fim da vida útil do produto, desinfete o circuito e então o descarte como lixo hospitalar não contaminado.

Declaração de Garantia:

A Fisher & Paykel Healthcare garante que o circuito Evatherm™, quando utilizado de acordo com as instruções de utilização, não deve apresentar defeitos de fabricação ou de material e apresentará desempenho de acordo com as especificações oficiais da Fisher & Paykel Healthcare relativas ao produto por um período de 90 dias a partir da data de compra pelo usuário final. Esta garantia está sujeita às limitações e exceções detalhadas em <http://www.fphcare.com/evalthermwarranty>



Se bruksanvisningen för befuktare MR810 för ytterligare information om inställning och korrekt användning.

Avsedd användning

Fisher & Paykel Healthcare 900MR810 slangset för vuxna är utformat för att användas tillsammans med befuktaren MR810 för att tillföra terapeutisk värme och fukt till patientens inandningsgaser vid behandling med ett kontinuerligt eller periodiskt ventilatorsystem eller ett kontinuerligt gasflödesystem.

Tillsatsen av fukt och värme hjälper till att förhindra att patientens luftvägar torkas ut av den kalla och torra ventilatorgasen. MR810-systemet är utformat för att användas på sjukhus, vårdboenden och vårdhem efter ordination av kvalificerad vårdpersonal.

Symbol:



Patientände

Rengöring/desinficering

Använd endast de godkända desinficerings- och rengöringsmetoder som beskrivs i dessa anvisningar:



Kassera slangar och alla slangsetets komponenter efter 20 rengöringscykler, eller sex månader efter första användning, beroende på vilket som inträffar först. Överskrid inte de rekommenderade maximala rengöringstemperaturerna, eftersom högre rengöringstemperaturer kan skada slangsetet. Använd inte automatisk diskmaskin/rengöringsapparat, eftersom detta kan skada slangsetet.

Anvisningar för rengöring och desinficering:

Steg 1–Rengöring:



Försiktighet: Använd lämplig personlig skyddsutrustning vid rengöring, såsom: Engångshandskar, stänkskydd/skyddsglasögon och skyddsrock.

- Ta isär slangsetet

OBS! Rengör slangan så snart som möjligt efter användning.
- Skölj slangsetets komponenter direkt efter användning, med varmt kranvatten (<40 °C).
- Fyll en diskho/behållare med varmt vatten (<40 °C) och natriumhypoklorit, till en maximal koncentration på 0,5%. Blötlägg sedan slangarna och komponenterna i 30–40 minuter.
- Rengör insidan av slangan och avlägsna all synlig smuts, om det behövs, med en mjuk flaskborste. Använd inte hårda borstar inuti slangan.
- Skölj insidan och utsidan av slangan noggrant med varmt kranvatten för att avlägsna återstående natriumhypoklorit och smuts.
- Häng slangarna vertikalt upprätt för att avlägsna överflödigt vatten. Slangarna kan lufttorkas i upp till 75 °C.



Varning: Rengör eller torka inte slangsetet med lösningsmedel eller alkohol.

- Fortsätt till höggradig desinficering, steg 2.

Steg 2 – Höggradig desinficering:

Använd en av desinficeringsmetoderna som visas:

a. Desinficering med 0,3 % ortoftalaldehyd (OPA) -kemikalie:



Försiktighet: Före hantering av OPA Använd lämplig personlig skyddsutrustning såsom: Engångshandskar, stänkskydd/skyddsglasögon och skyddsrock. Se till att desinficering utförs i ett dragskåp eller med rökutsugning. Läs OPA-tillverkarens bruksanvisning.

- Fyll en diskho/behållare med desinficeringsmedel OPA 0,3 %, såsom Johnson and Johnson Cidex OPA (följ tillverkarens bruksanvisning för korrekt beredning av OPA). Sänk ned slang och komponenter helt i desinficeringsmedlet. Blötlägg i minst 30 minuter. Avlägsna sedan alla delar från OPA.
- Byt handskar.
- Skölj slangarna och komponenterna med steril vatten (följ tillverkarens bruksanvisning för korrekt sköljningsförfarande för OPA).
- Häng slangarna vertikalt för att låta dem lufttorka. Slangarna kan lufttorkas i upp till 75 °C. Inspektera slangsetets komponenter och kontrollera om det finns några sprickor, brott eller skador. Sätt ihop andningsslangsetet igen när alla komponenter är torra. Förvara slangsetet i torr och dammfri miljö, redo för nästa användning.

b. Desinficering genom pastörisering:

- Se till att pastöriseringsapparatet är inställt på kontroll mellan 75 och 78 °C maximalt.

OBS! Högre temperaturer än 78 °C skadar andningsslangen och förkortar dess livslängd.
- Lämna slangsetets komponenter i pastöriseringsapparat i 30 till 40 minuter.
- Avlägsna slangsetets komponenter, häng slangarna att torka vertikalt. Slangarna kan lufttorkas i upp till 75 °C. Inspektera slangsetets komponenter och kontrollera om det finns några sprickor, brott eller skador. Sätt ihop andningsslangsetet igen när alla komponenter är torra. Förvara slangsetet i torr och dammfri miljö, redo för nästa användning.

c. Autoklav:



Varning: Endast slangsetanslutningarna kan autoklaveras. Autoklavering förstör slangarna.

- Se till att autoklaven är inställd på antingen 121 °C eller 136 °C.

Lämna slangsetanslutningarna i autoklaven i 30 minuter vid 121 °C eller 4 minuter vid 136 °C. Inspektera slangsetanslutningarna och kontrollera om det finns några sprickor eller skador. Sätt ihop slangsetanslutningarna med de desinficerade slangarna när alla anslutningar är torra. Förvara slangsetet i torr och dammfri miljö, redo för nästa användning.

Tekniska specifikationer:



Typ BF

Gränssnittsanslutningar: ISO 5356-1 eller ISO 5367

Driftsintervall för omgivningstemperatur och inloppsgas:18–26 °C

Maximal administrerad temperatur:<40 °C

	900MR810
Drift:	4,6 mL/kPa/m
Kompressibel volym:	640 mL
Läckagehastighet:	<25 mL/min vid 6 kpa
Motstånd mot flöde vid nominellt flöde:	0,4 cmH ₂ O vid 60 ± 1 L/min
Flödesomfång:	≥5 till ≤60 L/min *

* Testad med kammare MR370



Varning:

- Rengör kretsen före användning och efter varje patientanvändning endast med godkända desinficeringsmetoder.Användning av ej godkända rengöringsmetoder kan skada slangsetet och minska dess livslängd.
- Måste ställas in och användas av utbildad sjukvårdspersonal.
- Inspektera slangsetet före återanvändning. Slangsetet får inte användas om det uppvisar tecken på försämring såsom sprickor, brott eller skada.
- Får endast användas med Fisher & Paykel MR810, befuktningskammare och tillbehör.
- Se till att befuktaren alltid är placerad lägre än patientens luftvägar.
- Fyll inte kammaren med vatten som är varmare än 37 °C.
- Ställ in lämpliga ventilatoralarm.
- Säkerställ att anslutningen med patientsymbolen är placerad vid slangsetets patientände.
- Använd ett vattenlås i utandningsslangen när så är tillämpligt.
- Kontrollera att alla slanganslutningar är ordentligt åtdragna före användning.
- Utför ett tryck- och läckagetest på andningssystemet och leta efter blockeringar före anslutning till patient.
- Se till att hela slangsetet fungerar korrekt, med erforderliga ventilatorinställningar, innan det ansluts till patient.
- Kontrollera regelbundet om det finns kondens i slangarna och vattenlås, och töm efter behov.
- Använd inte det uppvärmda slangsetet utan gasflöde. Stäng av befuktaren om gasflödet avbryts.
- Täck inte setet med material såsom filtar, handdukar eller sänglinne.
- Ytttemperaturen kan nå 43 °C. Långvarig kontakt mellan slangan och patientens exponerade hud kan leda till tryckskada eller hudskada.
- Slangan får inte klämmas.
- Detta systems befuktningsuttryffekt kan överskridas om det används utanför rekommenderat omgivningstemperatur- eller flödesintervall.
- Utrustningen får inte ändras eller modifieras.
- Koppla från slangan endast genom att hantera ändanslutningarna. Dra eller vrid inte slangan, eftersom detta kan orsaka skada.
- Kontrollera regelbundet vattennivån i befuktningskammaren och fyll på efter behov.
- Exponera inte slangarna för stark UV-strålning.
- Kassera slangar och alla slangsetets komponenter efter 20 rengöringscykler, eller sex månader efter första användning, beroende på vilket som inträffar först. Desinficera slangsetet vid slutet av dess livslängd, och kassera det sedan som okontaminerat medicinskt avfall.

Garantideclaration:

Fisher & Paykel Healthcare garanterar att Evatherm™-slangsetet, vid användning enligt bruksanvisningen, är fritt från defekter i tillverkning och material och fungerar i enlighet med Fisher & Paykel Healthcare's officiella publicerade produktspecifikationer i 90 dagar från slutanvändarens inköpsdatum. Denna garanti gäller med de begränsningar och undantag som anges i detalj på <http://www.fphcare.com/evalthermwarranty>



Der henvises til brugervejledningen til MR810 befugteren for yderligere oplysninger om opsætning og korrekt anvendelse.

Tilsigtet anvendelse

Fisher & Paykel Healthcare 900MR810 åndedrætskredslob til voksne er designet til brug sammen med MR810 befugteren for at tilføre terapeutiske niveauer af varme og luftfugtighed til en patients indåndingsgasser, når der anvendes et kontinuerligt eller intermitterende respiratorsystem eller et kontinuerligt gasstrømssystem.

Tilføjelse af varme og fugt til de kolde og tørre indåndingsgasser, der tilføres via ventilationen, hjælper med at forhindre udtørring af patientens luftveje. MR810 systemet er designet til brug på hospitaler, langtidsplejefaciliteter og i hjemmet, når det er ordineret af kvalificeret lægefagligt personale.

Symbol:



Patientenden

Rengöring/desinfektion

Anvend kun godkendte desinfektions- og rengøringsmetoder som anvist i nedenstående instruktioner:



Slangar og alle kredsløbskomponenter skal kasseres efter 20 rengøringscykler eller seks måneder efter første anvendelse, alt efter hvad der kommer først. Den anbefalede maksimale rengøringsstemperatur må ikke overskrides, da højere rengøringsstemperaturer kan beskadige kredsløbet. Brug ikke automatiseret vaske-/rengøringsapparat, da det kan beskadige kredsløbet.

Rengørings- og desinfektionsinstruktioner:

Trin 1–Rengöring:



Forsigtig: Brug passende personlige værnemidler under rengöring såsom: engangshandsker, visir mod sprøj/beskyttelsesbriller og beskyttelsesdragt.

- Adskil kredsløbet

BEMÆRK: Rengör kredsløbet hurtigst muligt efter brug.
- Skyl kredsløbets komponenter umiddelbart efter brug med varmt vand fra hanen (<40 °C).
- Fyld en vask/beholder med varmt vand (<40 °C) og natriumhypoklorit med en maksimal koncentration på 0,5%. Læg derefter slang og komponenter i blød i 30–40 minutter.
- Rengör indersiden af slang, og fjern om nødvendigt al synlig debris med en blød flaskerenser. Brug ikke hårde børster inden i slang.
- Skyl slang grundigt indvendigt og udvendigt med varmt vand fra hanen for at fjerne resterende natriumhypoklorit og debris.
- Hæng slangerne op lodret for at fjerne overskydende vand. Slangerne kan lufttørres ved op til 75 °C.



Advarsel: Kredsløbet må ikke rengøres eller tørres med opløsningsmidler eller alkohol.

- Fortsæt til high level-desinficering, trin 2.

Trin 2 – High level-desinficering:

Brug en af de viste desinficeringsmetoder:

a. Desinficering med 0,3 % af kemikaliet ortophthalaldehyd (OPA):



Forsigtig: Før håndtering af OPA Brug passende personlige værnemidler såsom: engangshandsker, visir mod sprøj/ beskyttelsesbriller og beskyttelsesdragt. Sørg for, at desinficering sker i et stinkskab, eller at der anvendes udsugning. Læs OPA-producentens brugsvejledning.

- Fyld en vask/beholder med desinficerende OPA 0,3%, som fx Johnson og Johnson Cidex OPA (følg producentens anvisninger for korrekt klargöring af OPA). Nedsänk slang og komponenter helt i desinficeringsmidlet. Lad dem ligge i blød i minimum 30 minutter. Fjern derefter alle dele fra OPA-midlet.
- Skift handsker.
- Skyl slang og komponenter med steril vand (følg producentens anvisninger for korrekt OPA-skylleprocedure).
- Hæng slangene op lodret for at lade dem lufttørre. Slangerne kan lufttørres ved op til 75 °C. Kontrollér slang og kredsløbskomponenterne. Undersøg om der er brud, revner eller skader. Når alle komponenter er tørre, samles åndedrætskredsløbet igen. Gem kredsløbet på et tørt og støvfrit sted, så det er klar til brug næste gang.

b. Desinficering ved pasteurisering:

- Sørg for, at pasteuriseringsapparatet indstilles til et temperaturområde på maks. 75 til 78 °C.

BEMÆRK: Temperaturer højere end 78 °C vil beskadige patientslang og forkorte dens levetid.
- Lad kredsløbets komponenter være i pasteuriseringsapparatet i ca. 30 til 40 minutter.
- Tag kredsløbets komponenter ud, og hæng slangerne til tørre lodret. Slangerne kan lufttørres ved op til 75 °C. Kontrollér slang og kredsløbskomponenterne. Undersøg om der er brud, revner eller skader. Når alle komponenter er tørre, samles åndedrætskredsløbet igen. Gem kredsløbet på et tørt og støvfrit sted, så det er klar til brug næste gang.

c. Autoklave:



Advarsel: Det er kun kredsløbstilslutningerne, der kan autoklaveres. Autoklavering vil ødelægge slangerne.

- Sørg for, at autoklaven er indstillet til enten 121 °C eller 136 °C.

Lad tilslutningerne blive i autoklaven i 30 minutter ved 121 °C eller 4 minutter ved 136 °C. Kontrollér kredsløbstilslutningerne. Undersøg om der er brud, revner eller skader. Når alle tilslutningerne er tørre, sættes kredsløbstilslutningerne igen sammen med de desinficerede slang. Gem kredsløbet på et tørt og støvfrit sted, så det er klar til brug næste gang.

Tekniske specifikationer:



Type BF

Interfacetilslutninger: ISO 5356-1 eller ISO 5367

Omgivende temperatur og driftsområde for indåndingsluft:18 °C – 26 °C

Maksimal leveret temperatur:<40 °C

	900MR810
Komplians:	4,6 mL/kPa/m
Komprimerbart volumen:	640 mL
Lækagehastighed:	<25 mL/min ved 6 kpa
Flowmodstand ved nominelt flow:	0,4 cmH ₂ O ved 60 ± 1 L/min
Flowområde:	≥5 til ≤60 L/min *

* Testet med MR370-kammer





Vi henviser til bruksanvisningen for fukteren MR810 for ytterligere informasjon om klargjøring og korrekt bruk.

Tiltenkt bruk

Fisher & Paykel Healthcare 900MR810 pusteslange for voksne er utformet for bruk med MR810-fukteren for å gi terapeutiske varme- og fuktighetsnivåer til en pasients pustegasser, ved bruk av et kontinuerlig eller vekslende ventilatorsystem eller et kontinuerlig gasssystem.

Tilføring av varme og fuktighet til forsyningen av kalde og tørre pustegasser som leveres via ventilering, forhindrer at pasientens luftveier uttørres. MR810-systemet er utformet for bruk på sykehus, ved institusjoner for langtidsspleie og i hjemmet på resept fra kvalifisert helsepersonell.

Symbol:



Rengjøring/desinfisering

Vi bruker kun de godkjente desinfiserings- og rengjøringsmetodene som beskrives i disse instruksjonene:

- Kasser slanger og alle kretskomponenter etter det som inntreffer først av 20 rengjøringscykluser eller seks måneder etter første gangs bruk.
- Ikke overskrid anbefalingene for maksimale rengjøringsstemperaturer, da høyere temperaturer kan skade kretsen.
- Ikke bruk automatisert vaske-/rengjøringsmaskin, da dette kan skade kretsen.

Instruksjoner for rengjøring og desinfisering:

Trinn 1 – Rengjøring:



Forsiktig: Bruk passende personlig verneutstyr under rengjøring, som: engangshansker, ansiktsskjerm/vernebriller og beskyttende frakk.

- Demonter kretsen.
 - MERK: Rengjør kretsen snarest mulig etter bruk.
- Skyll kretskomponentene rett etter bruk under varmt springvann (<40 °C).
- Fyll en kumbeholder med varmt vann (<40 °C) og natriumhypokloritt til maks. 0,5 % konsentrasjon. Legg slanger og komponenter i bløt i 30–40 minutter.
- Rengjør innsiden av slangene for å fjerne alle synlige rester, om nødvendig. Bruk en myk kost. Ikke bruk harde koster til slangene.
- Skyll utsiden og innsiden av slangene grundig med varmt springvann for å fjerne rester av natriumhypokloritt og andre urenheter.
- Heng slangene vertikalt for at vannet skal renne ut. Slangene kan lufttørkes ved opptil 75 °C.



Advarsel: Kretsen må ikke rengjøres eller tørkes med løsemidler eller alkohol.

- Gå til desinfisering på høyt nivå, trinn 2.

Trinn 2 – Desinfisering på høyt nivå:

Bruk en av metodene for desinfisering som vises:

a. Desinfisering med 0,3 % ortoftalaldehyd (OPA):



Forsiktig: Før du håndterer OPA Bruk passende personlig verneutstyr, som: engangshansker, ansiktsskjerm/vernebriller og beskyttende frakk. Påse at desinfiseringen gjøres med tilstrekkelig røykavtrekk. Les OPA-produsentens bruksanvisning.

- Fyll en kumbeholder med desinfiserende OPA 0,3 %, som Johnson and Johnson Cidex OPA (følg produsentens anvisninger for korrekt klargjøring av OPA). Senk slanger og komponenter helt ned i den desinfiserende løsningen. La dem ligge i bløt i 30 minutter. Ta deretter delene ut av OPA-løsningen.
- Skift hansker.
- Skyll slangene og komponentene med steril vann (følg produsentens anvisninger for korrekt skyllemetode for OPA).
- Heng slangene vertikalt for at de skal lufttørke. Slangene kan lufttørkes ved opptil 75 °C. Inspiser slangene og kretskomponentene og sjekk om de har sprekker, rifter eller annen skade. Når alle komponentene er tørre, setter du sammen pustekretsen igjen. Oppbevar kretsen på et tørt og støvfritt sted, klar til neste gangs bruk.

b. Desinfisering ved pasteurisering:

- Forsikre deg om at pasteuriseringsapparatet stilles på maksimalt 75–78 °C.
 - MERK: Temperaturer over 78 °C vil skade pusteslangen og forkorte dens levetid.
- Ta ut kretskomponentene og heng slangene vertikalt for å tørke. Slangene kan lufttørkes ved opptil 75 °C. Inspiser slangene og kretskomponentene og sjekk om de har sprekker, rifter eller annen skade. Når alle komponentene er tørre, setter du sammen pustekretsen igjen. Oppbevar kretsen på et tørt og støvfritt sted, klar til neste gangs bruk.

c. Autoklaving:



Advarsel: Det er kun kretskoblingene som kan autoklaveres. Autoklaving vil ødelegge slangene.

- Påse at autoklaven stilles på enten 121 °C eller 136 °C. La kretskoblingene ligge i autoklaven i 30 minutter ved 121 °C eller i 4 minutter ved 136 °C. Inspiser kretskoblingene og sjekk om de har sprekker eller annen skade. Når alle koblingene er tørre, setter du sammen kretskoblingene igjen for å desinfisere slangene. Oppbevar kretsen på et tørt og støvfritt sted, klar til neste gangs bruk.

Tekniske spesifikasjoner:



Type BF

Grensesnittkontakter: ISO 5356-1 eller ISO 5367

Driftsområde for omgivelsestemperatur og inntaksgass:18–26 °C

Maks. forsynt temperatur: <40 °C

	900MR810
Kapasitet:	4,6 mL/kPa/m
Kompressibelt volum:	640 mL
Lekkasjehastighet:	<25 mL/min ved 6 kPa
Flowmotstand ved nominell flow:	0,4 cmH ₂ O ved 60 ± 1 L/min
Flowområde:	≥5 til ≤60 L/min *

* Testet med MR370-kammer



Advarsel:

- Rengjør kretsen for bruk og etter hver pasientbruk, kun med godkjente desinfiseringsmetoder. Bruk av ikke-godkjente rengjøringsmetoder kan skade kretsen og redusere dens levetid.
- Må klargjøres og brukes av helsepersonell med nødvendig opplæring.
- Inspiser kretsen før den brukes igjen. Ikke bruk kretsen hvis den viser tegn på forringelse, som: sprekker, rifter eller annen skade.
- Må kun brukes sammen med Fisher & Paykel MR810 fuktekammer og tilbehør.
- Påse at fukteren alltid plasseres lavere enn pasienten.
- Ikke fyll kammeret med vann som holder mer enn 37 °C.
- Still inn aktuelle ventilatoralarmer.
- Påse at koblingen med pasientsymbollet sitter i kretsens pasientende.
- Bruk en vannlås på eksprasjonsslangen om nødvendig.
- Kontroller at alle slangeforbindelser er tette før bruk.
- Utfør en trykk- og lekkasjetest på pustesystemet og se etter blokkeringer før du kobler til en pasient.
- Påse at hele kretsen virker korrekt med de nødvendige ventilatorinnstillingene før du kobler til en pasient.
- Sjekk kretsslengene og vannlåsene jevnlig for kondensat. Tapp av etter behov.
- Ikke bruk den oppvarmede pustekretsen uten gasflow. Hvis gasflowen avbrytes, må fukteren slås av. Ikke dekk til kretsen med materialer som tepper, håndklær eller sengetøy.
- Temperaturen på overflaten kan nå 43 °C. Langvarig kontakt mellom en kretsslange og pasientens eksponerte hud kan føre til trykk- og hudskade.
- Kretsslengene må ikke klemmes.
- Fuktigheten fra systemet kan kompromitteres hvis kretsen brukes utenfor anbefalt omgivelsestemperatur eller flowområde.
- Det er ikke tillatt å modifisere dette utstyret.
- Slangene må kun frakobles ved å gripe i endekoblingene. Ikke trekker vri slangene, da dette kan medføre skade.
- Kontroller vannstanden i fuktekammeret jevnlig og etterfylt ved behov.
- Ikke utsett slangene for sterk UV-stråling.
- Kasser slanger og alle kretskomponenter etter det som inntreffer først av 20 rengjøringscykluser eller seks måneder etter første gangs bruk. Ved endt levetid skal kretsen desinfiseres og kasserne som ikke-kontaminert medisinsk avfall.

Garantierklæring:

Fisher & Paykel Healthcare garanterer at Evatherm™-kretsen, når den brukes i samsvar med bruksanvisningen, vil være fri for defekter i utførelse og materialer, og at den vil fungere i samsvar med Fisher & Paykel Healthcares publiserte produktspesifikasjoner i en periode på 90 dager fra sluttbrukers innkjøpsdato. Denne garantien er underlagt begrensninger og unntak som beskrives nærmere i <http://www.fphcare.com/evathermwarranty>



MR810-kostutimen käyttöohjeissa annetaan lisää valmistelua ja käyttöä koskevia ohjeita.

Käyttötarkoitus

Fisher & Paykel Healthcaaren aikuisille tarkoitettu 900MR810-hengityslaitteisto on tarkoitettu käytettäväksi MR810-kostutimen kanssa potilaan sisään hengittämien hengityskaasujen lämmön ja kosteuden pitämiseksi hoitotilassa, kun käytetään jatkuvaa tai jaksittaista ventilaattorijärjestelmää tai jatkuvatoimista kaasuvirtausjärjestelmää.

Lämmön ja kosteuden lisääminen kylmiin ja kuiviin hengityskaasuuhin auttaa ehkäisemään potilaan hengitysteiden kuivumista. MR810-järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi pätevän lääketieteen ammattilaisen määräyksestä sairaaloissa, pitkäaikaishoitolaitoksissa ja kotihoidossa.

Symboli:



Puhdistaminen/desifiointi

Käytä vain hyväksytyjä desinfiointi- ja puhdistusmenetelmiä näiden ohjeiden mukaisesti:



- Hävitätä letkut ja kaikki letkuston osat 20 puhdistussyklin jälkeen tai kuusi kuukaudesta ensimmäisen käyttöönoton jälkeen, kumpi tahansa näistä saavutetaan ensin.
- Älä ylitä suositeltuja enimmäislämpötiloja puhdistamisen aikana, koska korkeammat puhdistuslämpötilat voivat vaurioittaa letkustoa.
- Älä käytä automaattista pesuriäpuhdistuslaitteistoa, koska se voi vaurioittaa letkustoa.

Puhdistamis- ja desinfiointiohjeet:

Vaihe 1 – puhdistaminen:



Huomio: Käytä puhdistamisen aikana asianmukaisia henkilökohtaisia suojarusteita, kuten kertakäyttöisiä käsineitä, roiskeilta suojaavaa kasvosuojusta/suojalaseja ja suojaakaapua.

- Pura letkusto osiin.
 - HUOMAUTUS: puhdistat letkusto mahdollisimman pian käytön jälkeen.
- Huuhtelet letkuston osat heti käytön jälkeen lämpimällä vesijohtovedellä (<40 °C).
- Täytä allas/astia lämpimällä vedellä (<40 °C) ja natriumhypokloriitilla, jonka pitoisuus on enintään 0,5 %. Liota sitten letkuja ja osia 30–40 minuutin ajan.
- Huuhtelet letkun sen sisällä. Poista kaikki näkyvä lika tarvittaessa pehmeällä pulloharjalla. Älä käytä kovia harjoja letkun sisällä.
- Huuhtelet letkun sisä- ja ulkopuoli perusteellisesti lämpimällä vesijohtovedellä, jotta natriumhypokloriittijäämät ja lika saadaan poistettua.
- Ripusta letkut kuivumaan pystysuoraan asentoon liiallisen veden poistamiseksi. Letkut voidaan ilmakuijata korkeintaan 75 °C:n lämpötilassa.



Varoitus: älä puhdistat tai kuivaa letkustoa luottimilla tai alkoheilla.

- Jatka perusteelliseen desinointiin, vaihe 2.

Vaihe 2 – perusteellinen desinointi:

Käytä yhtä alla esitetyistä desinointimenetelmistä:

a. Desinointi 0,3 prosentinortoftaalialdehydi (OPA) -kemikaalilla:



Huomio: Ennen OPA-käsittelyä Käytä sopivia henkilökohtaisia suojarusteita, kuten kertakäyttöisiä käsineitä, roikesuojaa/suojalaseja ja suojaakaapua. Varmista, että desinointi suoritetaan vetokaapissa tai höyrypoistoa käyttäen. Lue OPA:n valmistajan käyttöohjeet.

- Täytä allas/astia 0,3% OPA-desinointiaineeilla, kuten Johnson and Johnson Cidex OPA (noudata valmistajan ohjeita valmistellessasi OPA:n). Upota letku ja osat kokonaan desinointiaineseen. Liota vähintään 30 minuutin ajan. Poista sitten kaikki osat OPA:sta.
- Vaihda käsineet.
- Huuhtelet letkut ja osat steriilillä vedellä (noudata valmistajan ohjeita OPA:n oikean huuheltoimenpiteen suhteen).
- Ripusta letkut pystysuoraan kuivumaan ilmassa. Letkut voidaan ilmakuijata korkeintaan 75 °C:n lämpötilassa. Tutki letku ja letkuston osat. Tarkista, ettei mitään murtumia, repeämiä tai vaurioita ole näkyvissä. Kun kaikki osat ovat kuivia, kokoa hengityslaitteisto uudelleen. Säilytä letkusto kuivassa ja polyttömässä ympäristössä seuraavaa käyttöä varten.

b. Desinointi pastöroimalla:

- Varmista, että pastörointilaitte on asetettu maksimilämpötilaan 75–78 °C.
 - HUOMAUTUS: yli 78 °C:n lämpötila vaurioittaa hengityslaitteita ja lyhentää sen käyttöikää.
- Jätä letkusto osat pastörointilaitteeseen 30–40 minuutiksi. Poista letkuston osat, ripusta letkut kuivumaan pystysuoraan. Letkut voidaan ilmakuijata korkeintaan 75 °C:n lämpötilassa. Tutki letku ja letkuston osat. Tarkista, ettei mitään murtumia, repeämiä tai vaurioita ole näkyvissä. Kun kaikki osat ovat kuivia, kokoa hengityslaitteisto uudelleen. Säilytä letkusto kuivassa ja polyttömässä ympäristössä seuraavaa käyttöä varten.

c. Autoklaavi:



Varoitus: Vain letkuston liittimet voidaan autoklavoida. Autoklavointi tuhoaa letkut.

- Varmista, että autoklaavi on asetettu joko 121 °C:n tai 136 °C:n lämpötilaan. Jätä letkusto liittimet autoklavoin 30 minuutiksi 121 °C:n lämpötilassa taineliksi 136 °C:n lämpötilassa. Tutki letkuston liittimet. Tarkista, ettei niissä ole murtumia, vaurioita. Kun kaikki liittimet ovat kuivia, kiinnitä letkuston liittimet uudelleen desinointiun letkustoon. Säilytä letkusto kuivassa ja polyttömässä ympäristössä seuraavaa käyttöä varten.

Tekniset tiedot:



BF-tyyppi

Laiteliitännät: ISO 5356-1 tai ISO 5367

Ympäristön lämpötila ja tulokaasun toiminta-alue: 18–26 °C

Annettu enimmäislämpötila: <40 °C

	900MR810
Komplianssi:	4,6 mL/kPa/m
Tilavuus kokoon puristettuna:	640 mL
Vuotonopeus:	<25 mL/min, 6 kPa
Virtausvastus määrättyllä virtausnopeudella:	0,4 cmH ₂ O, 60 ± 1 L/min
Virtausalue:	≥5 – ≤60 L/min *

* Testattu MR370-säiliöllä



Varoitus:

- Puhdistat letkusto ennen käyttöä ja jokaisen potilaskäytön jälkeen asianmukaisilla desinointimenetelmillä. Ei-hyväksytyjen puhdistusmenetelmien käyttö voi vaurioittaa letkustoa ja lyhentää sen käyttöikää.
- Vain koulutettu terveydenhuollon ammattilainen saa ottaa letkuston käyttöön ja käyttää sitä.
- Älä käytä letkusto ennen sen käyttöä uudelleen. Älä käytä, jos letkustossa näkyy heikkenemisen merkkejä, kuten murtumia, repeämiä tai vaurioita.
- Käytä vain Fisher & Paykel MR810 -kostutinsäiliöiden ja lisävarusteiden kanssa.
- Varmista, että kustutin on aina alempana kuin potilas.
- Älä täytä säiliötä vedellä, jona lämpötila ylittää 37 °C.
- Aseta ventilaattorin asianmukaisesti häilytykset.
- Varmista, että potilassymbolilla varustettu liitin sijaitsee letkuston potilaan puoleisessa päässä.
- Käytä tarvittaessa vedenerointa uloshengityslaitteissa.
- Tarkista ennen käyttöä, että kaikki letkujen liittännät ovat tiiviit.
- Suorita hengitysjärjestelmän paine- ja vuoto-testi ja tarkista järjestelmä tukkeutumien varalta ennen potilaaseen liittämistä.
- Ennen potilaaseen kytkemistä varmista, että täydellinen letkusto toimii oikein tarvittavilla ventilaattoriasetuksilla.
- Tarkista säännöllisesti letkusto ja vedenerotin tiivisteiden veden varalta ja valuta se tarvittaessa pois.
- Älä käytä lämmitettyä hengityslaitteisto ilman kaasuvirtausta. Jos kaasuvirtaus keskeytyy, kytket kustutin pois päältä.
- Älä peitä letkustoa peitteillä, pyyhkeillä, liinavaatteilla tai muilla materiaaleilla.
- Pinnan lämpötila voi olla jopa 43 °C. Pitkäaikainen letkuston kosketus potilaan ihoon voi johtaa painevammaan tai ihon vaurioitumiseen.
- Älä murskaa letkua.
- Tämän järjestelmän kosteuden tuotto voi heikentyä, jos sitä käytetään suositellun ympäristön lämpötilan tai virtausalueen ulkopuolella.
- Laitteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia.
- Irrota letku käsittelemällä vain päätyliittimä. Älä vedä tai kierrä letkua, koska tämä voi aiheuttaa vaurioita.
- Tarkista kustutinsäiliön veden määrä säännöllisesti ja täytä se tarpeen vaatiessa.
- Älä altista letkuja liialliselle UV-säteilylle.
- Hävitätä letkut ja kaikki letkuston osat 20 puhdistussyklin jälkeen tai kuusi kuukaudesta ensimmäisen käytön jälkeen, kumpi tahansa näistä saavutetaan ensin. Kun tuotteen käyttöikä on umpeutunut, desinointi letkusto ja hävitä se sitten kontaminoitumattomana lääketieteellisenä jätteinä.

Takuuta koskevalausunto:

Fisher & Paykel Healthcare takaa, että Evatherm™-letkusto, kun sitä käytetään käyttöohjeiden mukaisesti, ei sisällä valmistus- ja materiaavirheitä ja toimii Fisher & Paykel Healthcare -yhtiön virallisten julkistusten tuotemääritysten mukaisesti 90 vuorokauden ajan siitä päivästä lukien, jolloin loppukäyttäjät osti sen. Tätä takuuta koskevat rajoitukset ja poikkeukset, jotka esitetään tarkemmin osoitteessa <http://www.fphcare.com/evathermwarranty>




Информацию по дальнейшей настройке и правильному применению увлажнителя MR810 см. в руководстве пользователя.

Назначение

Дыхательный контур для взрослых 900MR810 компании Fisher & Paykel Healthcare предназначен для использования с увлажнителем MR810 для нагревания и увлажнения вдыхаемых пациентом в лечебных целях респираторных газов при использовании систем постоянной или прерывистой вентиляции или систем непрерывной подачи газа.

Нагревание и увлажнение холодных и сухих респираторных газов, подаваемых при вентиляции, служат для предотвращения высыхания дыхательных путей пациента. Система MR810 предназначена для использования в стационарах, учреждениях по оказанию длительного ухода и в домашних условиях по предписанию квалифицированных медицинских работников.

Условное обозначение.



Очистка/дезинфекция

Используйте только утвержденные методы дезинфекции и очистки, указанные в данной инструкции.



- Утилизируйте трубки и все компоненты контура после 20 циклов очистки/обеззараживания через шесть месяцев после первого использования, в зависимости от того, какое из событий произойдет раньше.
- Не превышайте максимальную рекомендуемую температуру очистки, поскольку при более высоких температурах может произойти повреждение контура.
- Не используйте автоматизированную аппаратуру для мойки/очистки, поскольку она может повредить контур.

Инструкциипоочисткеидезинфекции.

Шаг 1 – очистка.



Внимание. Приступая к очистке, наденьте соответствующую защитную одежду, например, одноразовые перчатки, экран для защиты от брызг либо защитные очки, защитный халат.

- Разберите контур.
 - ПРИМЕЧАНИЕ. Выполните очистку контура как можно раньше после использования.
- Сразу же после использования промойте компоненты контура под струей теплой водопроводной воды (<40 °C).
- Заполните раковину или сосуд теплой водой (<40 °C) и добавьте гипохлорит натрия до концентрации не более 0,5%. Замочите трубки и компоненты в этом растворе на 30–40 мин.
- Очистите внутреннюю поверхность трубок, удалив все видимые загрязнения. При необходимости используйте мягкую щетку для бутылок.Для очистки внутренней поверхности трубок не следует пользоваться жесткими щетками.
- Тщательно промойте внутреннюю и наружную поверхность трубки теплой водопроводной водой, чтобы удалить остатки гипохлорита натрия и загрязнений.
- Подвесьте трубки в вертикальном положении, чтобы удалить излишки воды. Трубки можно сушить воздухом с температурой не более 75 °C.



Предупреждение. Не пользуйтесь растворителями или спиртом для очистки и сушки контура.

- Переходитекдезинфекциивысокогоуровня, шаг 2.

Шаг 2 – дезинфекциявысокогоуровня.

Воспользуйтесьоднимизуказанныхметодовдезинфекции.

a. Химическаядезинфекциясприменением0,3% ортофталевогоальдегида (ОФА).



Внимание. Перед операциями ОФА Наденьте соответствующую защитную одежду, например, одноразовые перчатки, экран для защиты от брызг либо защитные очки, защитный халат. Убедитесь в том, что дезинфекция выполняется в условиях вытяжного шкафа или при наличии вытяжки. Прочтите инструкцию по применению ОФА, выпущенную производителем.

- Заполните раковину или сосуд дезинфектантом ОФА 0,3%, например, Johnson and Johnson Cidex OPA (соблюдайте инструкции производителя по правильному приговлению ОФА). Первоначально погрузите трубки и компоненты в дезинфектант. Замачивайте в течение не менее 30 минут. Затем извлеките все части из ОФА.
- Смените перчатки.
- Промойте трубки и компоненты стерильной водой (соблюдайте инструкции производителя по правильному выполнению процедуры промывки от ОФА).
- Подвесьте трубки вертикально и дайте им высохнуть на воздухе. Трубки можно сушить воздухом с температурой не более 75 °C. Осмотрите трубку и компоненты контура на предмет наличия трещин, разрывов или повреждений. После того, как все компоненты высохнут, повторно соберите дыхательный контур. Храните контур в сухом, защищенном от пыли месте, готовым для последующего использования.

b. Дезинфекция методом пастеризации.

- Убедитесь в том, что пастеризатор установлен на температуру от 75 °C до 78°С (максимум).
 - ПРИМЕЧАНИЕ. Использование температур выше 78 °C может привести к повреждению дыхательной трубки, а также снизить срок ее службы.
- Оставьте компоненты контура в пастеризаторе примерно на 30–40 минут.
- Извлеките компоненты контура, подвесьте трубки вертикально для сушки. Трубки можно сушить воздухом с температурой не более 75 °C. Осмотрите трубку и компоненты контура на предмет наличия трещин, разрывов или повреждений. После того, как все компоненты высохнут, повторно соберите дыхательный контур. Храните контур в сухом, защищенном от пыли месте, готовым для последующего использования.

c. Автоклавирование.



Предупреждение. Автоклавировать можно только соединители контура. Автоклавирование трубок приведет к их разрушению.

- Убедитесьвтом, чтоавтоклавнонастроенатемпература 121 °C или 136 °C. Поместитесоединителиконтуравававтоклава 30 минутпри 121 °C илина 4 минутпри 136 °C. Осмотритесоединителиконтуранадпредметналичиятрещинилиповреждений. Когдавсеединителивысохнут, сноваприсоединитеихкпродезинфицированнымтрубкам. Хранитеконтурвсухом, защищенномотпылиместе, готовымдляпоследующегоиспользования.

Технические



Kurulum ve doğru kullanım bilgisi için MR810 nemiendirici kullanım talimatlarını inceleyin.

Kullanım Amacı

Fisher & Paykel Healthcare 900MR810 yetişkin tipi solunum devresi, MR810 nemiendiriciyle birlikte kullanılmak suretiyle sürekli veya aralıklı ventilatör sistemleri veya sürekli gaz akış sistemleri kullanımını sırasında hastaya terapötik düzeylerde ısı ve nem sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Ventilyasyon yoluyla verilen soğuk ve kuru solunum gazlarına ısı ve nem eklenmesi hastanın havayolunındaki kurumayı önlemekte yararlıdır. MR810 Sistemi hastanelerde, uzun süreli bakım merkezlerinde ve evde nitelikli tip profesyonellerinin tavsiyesi ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Sembol:



Hasta Ucu

Temizleme/Dezenfeksiyon

Sadece bu talimatlarda belirtilen onaylı dezenfeksiyon ve temizleme yöntemlerini kullanın:



20 temizlemeden veya ilk kullanımdan altı ay sonra, hangisi daha önce gerçekleşirse, hortumları ve devre bileşenlerini çıkarın.
Önerilen maksimum temizleme sıcaklığı aşmayın. Daha yüksek temizleme sıcaklıkları devreye zarar verebilir.
Devreye zarar verebileceği için otomatik yıkayıcı/temizleyici kullanmayın.

Temizleme ve dezenfeksiyon talimatları:

Adım 1 – Temizleme:



Dikkat: Temizleme işlemi sırasında aşağıdaki uygun koruma araçlarını kullanın: Tek kullanımlık eldiven, koruyucu maske/gözlük ve koruyucu kıyafet.

- Devreyi sökün
NOT: Kullandıktan sonra devreyi ilk fırsatta temizleyin.
- Sıcak musluk suyu (<40°C) ile kullandıktan hemen sonra devre bileşenlerini durulayın.
- Bir lavaboyu/tekneyi sıcak su (<40°C) ve maksimum yoğunluğu %0,5 olan Sodyum Hipoklorit ile doldurun. Ardından boruları ve bileşenleri 30–40 dakika boyunca bu karışıma içinde bırakın.
- Hortumun içindeki görünür tüm atıkları temizleyin, gerekirse yumuşak bir şişe fırçası kullanın. Hortumun içinde sert fırçalar kullanmayın.
- Sodyum Hipoklorit atık kalıntılarını çıkarmak için hortumun içini sıcak musluk suyu ile iyice durulayın.
- Fazla suyu çıkarmak için hortumları dikey olarak asın. Hortumları 75°C'ye kadar olanhava ile kurulayabilirsiniz.



Uyan: Devreleri çözümler veya alkol ile temizlemeyin veya kurulamayın.

- Yüksek seviye dezenfeksiyona geçin, adım 2.

Adım 2 – Yüksek Seviye Dezenfeksiyon:

Gösterilen dezenfeksiyon yöntemlerinden birini kullanın:

a. %0,3 ortofitalaldehit (OPA) kimyasalı ile dezenfeksiyon:



Dikkat: OPA kullanımından önce aşağıdaki uygun koruma araçlarını kullanın: Tek kullanımlık eldiven, koruyucu maske/gözlük ve koruyucu kıyafet. Dezenfeksiyon işleminin bir çeker ocak veya gaz salıcı içinde gerçekleştirildiğinden emin olun. Kullanım için OPA üretici talimatlarını okuyun.

- Lavaboyu/tekneyi Johnson and Johnson Cidex OPA gibi bir dezenfektan OPA %0,3 ile doldurun (OPA'yı doğru şekilde hazırlamak için üretici talimatlarını uygulayın). Hortum ve bileşenleri dezenfektanın içine tamamen batırın.
En az 30 dakika boyunca bu şekilde bırakın. Ardından tüm parçaları OPA'dan çıkarın.
- Eldivenleri değiştirin.
- Hortumları ve bileşenleri steril su ile durulayın (Doğru OPA durulama prosedürünü gerçekleştirmek için üretici talimatlarını uygulayın).
- Hava ile kurumasi için hortumları dikey olarak asın. Hortumları 75°C'ye kadar olan hava ile kurutulabilir.
Hortum ve devre bileşenlerini denetleyin ve herhangi bir çatlak, yırtık veya hasar olup olmadığını kontrol edin.
Tüm bileşenler kurduğunda solunum devresini tekrar takın.
Devreyi kuru ve tozsuz bir ortamda, bir sonraki kullanıma hazır bir şekilde saklayın.

b. Pastörizasyon ile Dezenfeksiyon:

- Pastörizörün maksimum 75°C/164°F'ara kontrolle ayarlandığından emin olun.
NOT: 78°C'den yüksek sıcaklıklar nefes alma hortumuna zarar verecek ve onun kullanım süresini kısaltacaktır.
Devre bileşenlerini pastörizör içinde 30–40 dakika kadar bırakın.
- Devre bileşenlerini çıkarın ve hortumları kurumaları için dikey olarak asın. Hortumları 75°C'ye kadar olan hava ile kurulayabilirsiniz.
Hortum ve devre bileşenlerini denetleyin ve herhangi bir çatlak, yırtık veya hasar olup olmadığını kontrol edin.
Tüm bileşenler kurduğunda solunum devresini tekrar takın.
Devreyi kuru ve tozsuz bir ortamda, bir sonraki kullanıma hazır bir şekilde saklayın.

c. Otoklav:



Uyan: Sadece devre bağlayıcıları otoklavlanabilir. Otoklavlama hortumları bozacaktır.

- Otoklavın 121°C'ye veya 136°C'ye ayarlandığından emin olun.
Devre bağlayıcılarını 121°C'de 30 dakika veya 136°C'de 4 dakika boyunca otoklavda bırakın.
Devre bağlayıcılarını denetleyin ve herhangi bir çatlak veya hasar olup olmadığını kontrol edin.
Tüm bağlayıcılar kurduğunda devre bağlayıcılarını dezenfekte edilmiş hortuma bağlayın.
Devreyi kuru ve tozsuz bir ortamda, bir sonraki kullanıma hazır bir şekilde saklayın.

Teknik Özellikler:



Tür BF

Arayüz bağlantıları: ISO 5356-1 veya ISO 5367

Ortam sıcaklığı ve giriş camı işletim mesafesi:18°C – 26°C

Uygulanan maksimum sıcaklık:<40°C

	900MR810
Uygunluk:	4,6 mL/kPa/m
Sıkıştırılabilir hacim:	640 mL
Sızdırma oranı:	<25 mL/dk. @ 6 kpa
Nominal akışta akıntıya dayanıklılık:	0,4 cmH ₂ O @ 60 ± 1 L/ dk.
Akıntı mesafesi:	≥5 ila ≤60 L/ dk.*

- MR370 haznesi ile test edilmiştir.



Uyan:

- Devreyi kullanmadan önce ve her hasta kullanımından sonra, sadece onaylanmış dezenfeksiyon yöntemlerini kullanarak temizleyin.Onaylanmamış temizleme yöntemleri kullanmak devreye zarar verebilir ve onun kullanım süresini azaltabilir.
- Eğitilmiş medikal bir uzman tarafından ayarlanmalı ve kullanılmalıdır.
- Tekrar kullanımdan önce devreyi denetleyin. Devre yavaşlama veya çatlak, yırtık ya da hasar gibi bozulma belirtileri gösteriyorsa kullanmayın.
- Sadece Fisher & Paykel MR810, nemiendirme hazneleri ve aksesuarları ile kullanın.
- Nemiendiricinin hastadan daha fazla alpakta olduğundan emin olun.
- Hazneyi 37°C'den daha sıcak suyla doldurmayın.
- Uygun solunum cihazı alarmlarını kurun.
- Hasta sembolü taşıyan bağlayıcının devrenin hasta ucunda olduğundan emin olun.
- Uygulanabildiğinde ekspirasyon hattı içinde bir su kapalı kullanın.
- Kullanımdan önce tüm bağlantıların sıkı olduğunu kontrol edin.
- Hastaya bağlamadan önce solunum sistemi üzerinde bir basınç ve sızıntı testi yapın ve tıkanma olup olmadığını kontrol edin.
- Bir hastaya bağlamadan önce, tüm devrenin gerekli ventilatör ayarları ile doğru şekilde çalıştığından emin olun.
- Devre hortumlarını ve su kapanlarını yoğunlaşma açısından düzenli olarak kontrol edin ve gerektiği şekilde boşaltın.
- İstimali solunum devresini gaz akışı olmadan kullanmayın. Gaz akışı kesilirse nemiendiriciyi kapatın.
- Devreyi battaneye, havlu veya yatak çarşafı gibi malzemelerle örtmeyin.
- Yüzey sıcaklığı 43°C'ye ulaşmalıdır. Devre hortumunun hasta cildi ile gereğinden uzun süre teması basınç yaralanmalarına veya cilt hasarına yol açabilir.
- Devre hortumunu ezmeyin.
- Bu sistemin nem çıkışı, önerilen ortam sıcaklığının veya akım mesafesinin dışında kullanılırsa hasar görebilir.
- Bu cihazda değişiklik yapılmasına izin verilmez.
- Hortumu sadece uç bağlayıcılarını kullanarak sökün. Hasara neden olabileceği için çekmeyin veya bükmeyin.
- Nemiendirme haznesindeki su seviyesini düzenli olarak kontrol edin ve gerektiği kadar doldurun.
- Hortumları aşırı UV radyasyona maruz bırakmayın.
- 20 temizlemeden veya ilk kullanımdan altı ay sonra, hangisi daha önce gerçekleşirse, hortumları ve devre bileşenlerini çıkarın. Ürünün kullanım süresi dolduğunda devreyi dezenfekte edin. Ardından, kirletilmemiş medikal atık olarak kullanın.

Garanti Bildirimi:

Fisher & Paykel Healthcare, Evatherm™ devresinin, kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılması durumunda, son kullanıcısına ulaşmasından arından 90 gün boyunca, Fisher & Paykel Healthcare'in, yayımlanmış resmi ürün özellikleri ile uyumlu olarak performans göstereceğini ve malzemesi ile içiçliğini herhangi bir kusur meydana gelmeyeceğini garanti ederBu garanti, aşağıdaki linkte ayrıntılı olarakbelirtilen şartnamalara ve itisnalara tabidir
<http://www.fhpcare.com/evathermwarranty>



Należy odwołać się do podręcznika użytkownika nawilzacza MR810, aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji oraz prawidłowego użytkowania.

Zastosowanie

Obwód oddechowy dla dorosłych 900MR810 firmy Fisher & Paykel Healthcare jest przeznaczony do stosowania z nawilżaczem MR810 w celu zapewniania terapeutycznych poziomów ciepła i wilgotności oddechowych, wdychanych przez pacjenta , podczas stosowania systemu ciągłej lub przerywanej wentylacji albo za pomocą systemu ciągłego dostarczania gazu.

Grzewanie i nawilżanie dostarczanych zimnych i suchych gazów oddechowych, doprowadzanych za pomocą wentylacji, zapobiega wysuszeniu dróg oddechowych pacjenta. System MR810 zaprojektowano do użytku w szpitalach i placówkach opieki długoterwałej oraz do użytku domowego, po uzgodnieniu przepisaniu przez dyplomowanego lekarza.

Symbol:



Końcówka pacjenta

Czyszczenie/Dezynfekcja

Stosować wyłącznie zatwierdzone metody dezynfekcji i czyszczenia, które zostały przedstawione w niniejszym podręczniku:



Usunąć rurki i wszystkie części obwodu po 20 cyklach czyszczenia lub po sześciu miesiącach od pierwszego użycia, w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.
Nie przekraczać maksymalnych zalecanych temperatur czyszczenia, ponieważ wyższe wartości temperatury czyszczenia mogą uszkodzić obwód.
Nie stosować automatycznych zmywarek/oczyszczarek, ponieważ może to uszkodzić obwód.

Instrukcje dotyczące czyszczenia i dezynfekcji:

Krok 1 – Czyszczenie:



Przeostoga: Podczas czyszczenia stosować odpowiednie wyposażenie ochrony osobistej takie jak: rękawiczki jednorazowe, osłona przeciwodpryskowa/okulary ochronne i fartuch ochronny.

- Rozmontować obwód
UWAGA: Po użyciu wyczyć obwód najszybciej jak to możliwe.
- Bezpośrednio po użyciu przemyć części obwodu ciepłą wodą bieżącą (<40 °C). Napelnić zlew/zbiornik ciepłą wodą (<40 °C) i podchlorynem sodu do 0,5% maksymalnego stężenia. Następnie moczyć rurki oraz części przez 30–40 minut.
- Oczyszczyć wnętrze rurki usuwając wszystkie widoczne resztki (jeżeli zajdzie taka potrzeba) miękką szcawką do mycia butelek. Nie używać twardych szczotek do czyszczenia wnętrza rurki.
- Przemyć dokładnie część wewnętrzną i zewnętrzną rurki ciepłą wodą bieżącą, aby usunąć pozostały podchloryn sodu oraz resztki.
- Zawiesić rurki w pozycji pionowej, aby usunąć nadmiar wody. Rurki można osuszać powietrzem o temperaturze do 75 °C.



Ostrzeżenie: Nie czyścić i nie suszyć obwodu za pomocą rozpuszczalników bądź alkoholu.

- Przejsć do dezynfekcji wysokiego poziomu, krok 2.

Krok 2 – Dezynfekcja wysokiego poziomu:

Zastosować jedną z metod dezynfekcji podanych poniżej:

a. Dezynfekcja substancją chemiczną z 0,3% aldehydemorto-ftalowym (OPA):



Przeostoga: Przed zastosowaniem aldehydu orto-ftalowego Stosować odpowiednie wyposażenie ochrony osobistej takie jak: rękawiczki jednorazowe, osłona przeciwodpryskowa/okulary ochronne i fartuch ochronny. Upewnić się, że proces dezynfekcji odbywa się pod wyciągiem albo przy użyciu pochłaniacza oparów. Zapoznać się z instrukcją użycia wystawioną przez producenta aldehydu orto-ftalowego.

- Napelnić zlew/zbiornik środkiem dezynfekcyjnym z aldehydem orto-ftalowym 0,3%, takim jak Johnson and Johnson Cidex OPA (przestrzegać zaleceń producenta odnośnie prawidłowego przygotowania tego środka). Zanurzyć w całości rurkę i części w środku dezynfekcyjnym. Moczyć przez minimum 30 minut. Następnie wyjąć wszystkie części z aldehydu orto-ftalowego.
- Zmienić rękawiczki.
- Przemyć rurki i części wodą sterylną (przestrzegać zaleceń producenta odnośnie prawidłowego płukania w celu usunięcia aldehydu orto-ftalowego).
- Zawiesić rurki pionowo i pozwolić im wyschnąć na powietrzu. Rurki można osuszać powietrzem o temperaturze do 75 °C.
Skontrolować rurki i części obwodu, sprawdzić czy nie ma żadnych pęknięć, rozdarć lub uszkodzeń. Po wyschnięciu wszystkich części złożyć obwód oddechowy. Przechowywać obwód w suchym i wolnym od kurzu miejscu tak, aby był gotowy do dalszego użycia.

b. Dezynfekcja przez pasteryzację:

- Upewnić się, że pasteryzator jest ustawiony na kontrolę między maksymalnie 75 i 78 °C.
UWAGA: Temperatury wyższe niż 78 °C uszkadzają rurkę do oddychania i skrócą jej żywotność.
Pozostawić części obwodu w pasteryzatorze na czas od 30 do 40 minut.
- Zdjąć części obwodu, zawiesić rurki pionowo do wyschnięcia. Rurki można osuszać powietrzem o temperaturze do 75 °C.
Skontrolować złączki obwodu, sprawdzić czy nie ma żadnych pęknięć, rozdarć lub uszkodzeń. Po wyschnięciu wszystkich złączek obwodu połączyć je ze zdezynfekowanymi rurkami. Przechowywać obwód w suchym i wolnym od kurzu miejscu tak, aby był gotowy do dalszego użycia.

c. Autoklaw:



Ostrzeżenie: Tylko złączki obwodu nadają się do sterylizacji w autoklawie. Autoklawowanie niszczy rurki.

- Upewnić się, że autoklaw ustawiony jest na temperaturę 121 °C albo 136 °C.
Pozostawić złączki obwodu w autoklawie na okres 30 minut w temperaturze 121 °C albo na 4 minuty w temperaturze 136 °C.
Z badać złączki obwodu, sprawdzić czy nie ma żadnych pęknięć lub uszkodzeń.
Po wyschnięciu wszystkich złączek obwodu połączyć je ze zdezynfekowanymi rurkami. Przechowywać obwód w suchym i wolnym od kurzu miejscu tak, aby był gotowy do dalszego użycia.

Specyfikacje techniczne:



Typ BF

Złącza interfejsu: ISO 5356-1 lub ISO 5367

Temperatura otoczenia i zakres pracy dla gazu wlotowego:18 °C – 26 °C

Maksymalna dostarczana temperatura:<40 °C

	900MR810
Podatność:	4,6 mL/kPa/m
Objętość ściśnięta:	640 mL
Próba szczelności:	<25 mL/min @ 6 kpa
Opór płynięcia przy znamionowym przepływie:	0,4 cmH ₂ O @ 60 ± 1 L/min
Zakres przepływu:	≥5 do ≤60 L/min *

- * Testowano w komorze MR370



Ostrzeżenie:

- Obwód oczyścić przed użyciem i po każdym pacjencie, używając wyłącznie zaakceptowanych metod odkazania.Stosowanie niez zaakceptowanych metod czyszczenia może doprowadzić do uszkodzenia obwodu i do obniżenia jego żywotności.
- Obwód musibyc skonfigurowany i używany przez przeszkolony personel medyczny.
- Skontrolować obwód przed ponownym użyciem, nie używać jeżeli widoczne są oznaki puscia się takie jak: pęknięcia, rozdzierania lub uszkodzenia.
- Używać wyłącznie z komorami nawilzacza i akcesoriówi Fisher & Paykel MR810.
- Upewnić się, że nawilżacz znajduje się poniżej poziomu pacjenta.
- Nie napelniać komory wodą o temperaturze powyżej 37 °C.
- Ustawić właściwe alamy z sygnalem.
- Upewnić się, że złączka z wentylem pacjenta umieszczona jest w obwodzie na końcówce pacjenta.
- Jeżeli zajdzie potrzeba, zastosować skraplacz w odnodze wydechowej.
- Przed rozpoczęciem użytkowania upewnić się, że wszystkie połączenia są szczelne.
- Przed podłączeniem pacjenta przeprowadzić na obwodzie oddechowym test ciśnienia i szczelności oraz sprawdzić drożność.
- Przed podłączeniem pacjenta upewnić się, że cały obwód działa poprawnie, z wymaganymi ustawieniami wentylatora.
- Regularnie sprawdzać rurki obwodu oddechowego oraz skraplacz, w razie potrzeby wylewając skropliny.
- Nie stosować ogrzewanego obwodu oddechowego przy wyłączonej wentylacji i uszcodzenia skóry.
- Nie zginać rurki obwodu.
- Wylot wilgoci może ulec uszkodzeniu, jeżeli używany będzie w temperaturze otoczenia lub w zakresie przepływu wykraczających poza wartości zalecane.
- Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji tego urządzenia.
- Odczączyć rurkę trzymając wyłącznie za końcówki, nie ciągnąć i nie wyginać rurek, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
- Regularnie sprawdzać poziom wody w komorze nawilzacza i w razie konieczności dolać do pełna.
- Nie wystawiać rurek na nadmierne promieniowanie UV.
- Usunąć rurki i wszystkie części obwodu po 20 cyklach czyszczenia lub po sześciu miesiącach od pierwszego użycia, w zależności od tego, które nastąpi wcześniej. Pod koniec żywotności produktu, zdezynfekować obwód, a następnie zutylizować go jako nieszkodny odpad medyczny.

Ograniczenie gwarancji:

Fisher & Paykel Healthcare zarecza, że obwód Evatherm™, używany zgodnie z instrukcjami, będzie wolny odwad wykonania lub materiałowych i będzie działał zgodnie z oficjalnymi specyfikacjami opublikowanymi przezFisher & Paykel Healthcare przez okres 90 dni od daty zakupu dokonanego przez użytkownika końcowego. Niniejsza gwarancja podlega ograniczeniom i wyjątkom przedstawionym szczegółowo na stronie <http://www.fhpcare.com/evathermwarranty>



Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του υγραντήρα MR810 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και τη σωστή χρήση.

Προοριζόμενη χρήση

Το αναπνευστικό κύκλωμα για ενήλικες 900MR810 της Fisher & Paykel Healthcare έχει σχεδιαστεί για χρήση σε συνδυασμό με τον υγραντήρα MR810 για την παροχή θεραπευτικών επιπέδων θερμότητας και υγρασίας στα εισπνεόμενα αέρια ενός ασθενούς που χρησιμοποιεί σύστημα αναπνευστήρα συνεχούς ή διαλειπόντος αερισμού ή σύστημα συνεχούς ροής αερίου.

Η προσθήκη θερμότητας και υγρασίας στα ψυχρά και ξηρά αναπνευστικά αέρια που παρέχονται μέσω του αναπνευστήρα συμβάλλει στην αποτροπή της ξήρανσης των αεραγωγών του ασθενούς. Το Σύστημα MR810 είναι σχεδιασμένο για χρήση σε νοσοκομεία, ιδρύματα μακροχρόνιας περίθαλψης και κατ' οίκον κατόπιν συνταγής από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας.

Σύμβολο:



Άκρο προς τον ασθενή

Καθαρισμός/Απολύμανση

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες μεθόδους απολύμανσης και καθαρισμού όπως παρατίθενται στις παρούσες οδηγίες:



Απορρίψτε τους σωλήνες και όλα τα εξαρτήματα κυκλώματος μετά από 20 κύκλους καθαρισμού, ή έξι μήνες μετά την πρώτη χρήση, όποιο συμβεί πρώτο.
Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες συσσωμμένες θερμοκρασίες καθαρισμού, καθώς οι υψηλότερες θερμοκρασίες καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν το κύκλωμα.
Μη χρησιμοποιείτε αυτόματο πλυντήριο/συσκευή καθαρισμού, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει το κύκλωμα.

Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης:

Βήμα 1 – Καθαρισμός:



Προσοχή: Κατά τον καθαρισμό, να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προσωπικής προστασίας, όπως γάντια μίας χρήσης, συσκευή προστασίας προσωπικού/υλικιά ασφαλείας και προστατευτική ποδιά.

- Αποσυναρμολογήστε το κύκλωμα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθαρίστε το κύκλωμα το συντομότερο δυνατό μετά τη χρήση.
- Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα του κυκλώματος αμέσως μετά τη χρήση με ζεστό νερό βρύσης (<40°C). Γεμίστε ένα νεροχύτη/δοχείο με ζεστό νερό (<40°C) και υποχλωριώδες νάτριο μέχρι μέγιστη συγκέντρωση 0,5%. Στη συνέχεια μουλάστε τη σωλήνωση και τα εξαρτήματα για 30–40 λεπτά.
- Καθαρίστε το εσωτερικό του σωλήνα αφαιρώντας όλους τους ορατούς ρύπους, εάν χρειάζεται, με μαλακή βούρτσρα καθαρισμού φιαλών. Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες στο εσωτερικό του σωλήνα.
- Ξεπλύνετε το εσωτερικό και το εξωτερικό του σωλήνα πολύ καλά με ζεστό νερό βρύσης για να αφαιρέσετε τα κατάλοιπα υποχλωριωδούς νατρίου και ρύπων.
- Κρεμάστε τους σωλήνες κάβετα σε όρθια θέση για να αφαιρέσετε το περίσσιο νερό. Οι σωλήνες μπορούν να στεγνώσουν με αέρα σε θερμοκρασία μέχρι 75°C.



Προειδοποίηση: Μην καθαρίζετε ή στεγνώνετε το κύκλωμα με διαλύτες ή αλκοόλη.

- Συνεχίστε με την απολύμανση υψηλού επιπέδου, βήμα 2.

Βήμα 2 – Απολύμανση υψηλού επιπέδου:

Χρησιμοποιήστε μία από τις μεθόδους απολύμανσης που παρουσιάζονται παρακάτω:

α. Χημική απολύμανση με 0,3% ορθοφθαλδεύδη (OPA):



Προσοχή: Πριν την εργασία με OPA Φορέστε κατάλληλο εξοπλισμό προσωπικής προστασίας, όπως: γάντια μίας χρήσης, συσκευή προστασίας προσωπικού/υλικιά ασφαλείας και προστατευτική ποδιά. Διασφαλίστε ότι η απολύμανση διενεργείται σε επαγωγό αερίων ή με σύστημα απαγωγής των αναθυμιάσεων. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του OPA.

- Γεμίστε ένα νεροχύτη/δοχείο με απολυμαντικό OPA 0,3%, όπως Johnson and Johnson Cidex OPA (ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη σωστή παρασκευή του OPA). Εμβύθιστε το σωλήνα και τα εξαρτήματα τελείως στο απολυμαντικό. Αφήστε να μουλιάσουν για τουλάχιστον 30 λεπτά. Στη συνέχεια, αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από το OPA.
- Αλλάξτε γάντια.
- Ξεπλύνετε τους σωλήνες και τα εξαρτήματα με αποστειρωμένο νερό (ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη σωστή διαδικασία ξέπλυνσης του OPA).
- Κρεμάστε τους σωλήνες κάβετα και αφήστε τους να στεγνώσουν. Οι σωλήνες μπορούν να στεγνώσουν με αέρα σε θερμοκρασία μέχρι 75°C. Επιθεωρήστε το σωλήνα και τα εξαρτήματα κυκλώματος, ελέγξτε για τυχόν ρωγμές ή σχισίματα και άλλες ζημιές.
Όταν στεγνώσουν όλα τα εξαρτήματα, επανασυναρμολογήστε το αναπνευστικό κύκλωμα. Φυλάξτε το κύκλωμα σε ξηρό περιβάλλον χωρίς σκόνη, έτοιμο για την επόμενη χρήση.

β. Απολύμανση με παστερίωση:

- Διασφαλίστε ότι ο αποστειρωτής είναι ρυθμισμένος σε θερμοκρασία μεταξύ 75 και 78°C μέγιστο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θερμοκρασίες υψηλότερες από 78°C θα καταστρέψουν τον αναπνευστικό σωλήνα και θα μειώσουν τη διάρκεια ζωής του.
Αφήστε τα εξαρτήματα του κυκλώματος μέσα στον αποστειρωτή για περίπου 30 έως 40 λεπτά.
- Αφαιρέστε τα εξαρτήματα του κυκλώματος, κρεμάστε τους σωλήνες για να στεγνώσουν κάβετα. Οι σωλήνες μπορούν να στεγνώσουν με αέρα σε θερμοκρασία μέχρι 75°C. Επιθεωρήστε το σωλήνα και τα εξαρτήματα κυκλώματος, ελέγξτε για τυχόν ρωγμές ή σχισίματα και άλλες ζημιές.
Όταν στεγνώσουν όλα τα εξαρτήματα, επανασυναρμολογήστε το αναπνευστικό κύκλωμα. Φυλάξτε το κύκλωμα σε ξηρό περιβάλλον χωρίς σκόνη, έτοιμο για την επόμενη χρήση.

γ. Αυτοκάουστο:



Προειδοποίηση: Μόνο οι σύνδεσμοι κυκλώματος μπορούν να αποστειρωθούν σε αυτόκαυστο. Η αποστείρωση σε αυτόκαυστο θα καταστρέψει τους σωλήνες.

- Βεβαιωθείτε ότι το αυτόκαυστο είναι ρυθμισμένο είτε στους 121°C είτε στους 136°C. Αφήστε τους συνδέσμους κυκλώματος στο αυτόκαυστο για 30 λεπτά στους 121°C ή για 4 λεπτά στους 136°C.
Επιθεωρήστε τους συνδέσμους κυκλώματος, ελέγξτε για τυχόν ρωγμές ή άλλες ζημιές.
Όταν στεγνώσουν όλοι οι σύνδεσμοι, επανασυναρμολογήστε τους συνδέσμους κυκλώματος στην απολυασμένη σωλήνωση.
Φυλάξτε το κύκλωμα σε ξηρό περιβάλλον χωρίς σκόνη, έτοιμο για την επόμενη χρήση.

Τεχνικές προδιαγραφές:



Τύπος BF

Συνδέσεις διασύνδεσης: ISO 5356-1 ή ISO 5367

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος και λειτουργίας εισόδου αερίου:18°C – 26°C

Μέγιστη παρεχόμενη θερμοκρασία:&

日本語



追加設定を行う場合は、MR810加湿器の取扱説明書を参照し、用途情報の修正を行って下さい。

用途

Fisher & Paykel Healthcare 900MR810成人用呼吸装置回路は、MR810加湿器と併用する呼吸回路で、連続的または断続的換気装置や連続的ガスフローシステム使用時における吸気の加温と加湿を行います。

換気の際、湿度の低い冷たい呼吸ガスを加温・加湿すると、患者の気道の乾燥防止に役立ちます。MR810システムは、病院や長期療養施設、家庭での使用を意図しています。また、本製品の使用には、適切な資格を有する医療従事者の処方が必要です。

標識：



患者

洗浄及び消毒について

本指示書にて定めるように、既に認可されている消毒方法と洗浄方法のみ適用して下さい。

- チューブ並びに回路部品は全て、洗浄周期が20回に達した時点もしくは、最初の利用より6ヶ月経過後のいずれか、早い時期に廃棄して下さい。
- 高温で洗浄すると、回路を破損してしまふことがありますので、推奨する洗浄温度の上限を超えないようにして下さい。
- 回路を破損してしまふことがありますので、自動洗浄機、自動清掃装置などを使用しないで下さい。

洗浄及び消毒方法:

手順1 – 洗浄:

- 注意事項:** 洗浄作業を行う際は、使い捨てタイプの手袋、スブラッシュバイザーや保護メガネ、保護服の装着など人体を保護する装備を使用して下さい。

- 回路の解体
 - 注意: 使用後は、なるべく早めに回路の洗浄を行って下さい。
- 回路部品の使用後は、温水（40℃未満）で直接、濯ぎます。
- シンク或いは容器に温水（40℃未満）を張り、次亜塩素酸ナトリウムを濃度の上限0.5%になるように加えます。そして、中にチューブ類や部品類を30分から40分浸漬します。
- チューブの内側に肉眼で確認出来る破片を全て取り除いて洗浄を行い、必要であれば、ソフトタイプのピン洗浄ブラシを使います。チューブの内側には、ハードタイプの洗浄ブラシを使用しないで下さい。
- チューブの内側と外側を温水で濯ぎ、表面に残った次亜塩素酸ナトリウムと破片を取り除きます。
- チューブを垂直方向に真っ直ぐ立てた状態で吊るし、余分な水分を取り除きます。チューブを乾燥する際の温度は、75℃までになっています。



警告: 溶剤類やアルコール類で回路を洗浄しないで下さい。

- 手順2の高水準消毒に移ります。

手順2 – 高水準消毒

下記に示される方法の一つを使用してください。

a. 濃度0.3%のオルトフタルアルデヒド系(OPA)の薬剤を使って消毒:

- 注意事項:** OPAを取扱う前に使い捨てタイプの手袋、スブラッシュバイザーや保護メガネ、保護服など人体を保護する装備を行って下さい。ヒュームフード内か排煙設備を使用のもと、消毒作業を行うようにして下さい。OPA薬剤メーカーの取扱説明書を一読から使用します。

- シンク或いは容器をJohnson and Johnson Cidex社製OPAのような濃度0.3%のOPA消毒液で満たします（OPA液の調整方法については、メーカーの取扱説明書に従って下さい）。チューブや部品類が消毒液に完全に浸かるようにします。少なくとも30分間は、その中に浸して置くようにします。それから、OPA液より部品類を全て引き揚げます。
- 手袋を交換します。
- チューブと部品類を無菌水で濯ぎます（正しい濯ぎ作業方法については、OPAのメーカーの取扱説明書に従って下さい）。
- チューブを垂直に吊るして自然乾燥します。チューブを乾燥する際の温度は、75℃までになっています。チューブと回路部品類を点検し、亀裂や裂け目、破損などがないか確認します。部品類が全て乾いてから、呼吸回路を再度組立てます。回路を乾燥してほこりの出ない場所に保管し、次の使用に備えます。

b. 低圧殺菌装置を用いた消毒方法:

- 低圧殺菌装置は、必ず、75℃から最大温度78℃の間で設定を行うにして下さい。
 - 注意: 78℃以上の高温で行うと、呼吸管が破損したり、寿命が短くなることがあります。
- 低圧殺菌装置内に回路部品を30分から40分程度放置します。
 - 回路部品類を取り出し、チューブは垂直になるように吊ります。チューブを乾燥する際の温度は、75℃までになっています。
 - チューブと回路部品類を点検して、亀裂や裂け目、破損などがないか確認します。
 - 部品類が全て乾いたら、呼吸回路を再度組立てます。
 - 回路を乾燥してほこりの出ない場所に保管して、次の使用に備えます。

c. 高圧蒸気滅菌器:

- 警告:**高圧蒸気滅菌処理が出来るのは、回路部品類のみとなっています。チューブを高圧蒸気滅菌すると破損してしまいます。

- 高圧蒸気滅菌器の設定温度は、必ず121℃か136℃のいずれかになるように設定して下さい。121℃の設定温度の場合は、30分間、136℃の場合は、4分間、回路コネクタを高圧蒸気滅菌器に放置します。
 - 回路部品類を点検して、亀裂や裂け目、破損などがないか確認します。
 - コネクタが全て乾いたら、回路コネクタを消毒済みものチューブ類に再度組立てます。
 - 回路を乾燥してほこりの出ない場所に保管して、次の使用に備えます。

技術仕様:



BF型機器

インターフェイス接続: ISO 5356-1 及び ISO 5367に準拠

環境温度並びに入口ガス作動領域:18℃から26℃

出口最大温度:40℃未満

	900MR810
仕様標準:	4.6 mL/kPa/m
圧縮可能容量:	640 mL
リーク速度：	6kpa未満にて、25 mL/分
定格流量辺りの流動抵抗:	60 ± 1 L/分にて、0.4 cmH ₂ O
流量範囲:	5 L/分以上60 L/分以下*

- MR370にてチャンパーテスト済み



警告:

- 回路の洗浄は、使用前及び各患者使用后、認可された消毒方法を用いて行うようにして下さい。認可されていない洗浄方法を用いた場合、回路の破損を招いたり、寿命が短くなることがあります。
- 装置の設定及び取扱いは、熟練した医療専門家が行わなければなりません。
- 使用前には、回路を点検し、回路に亀裂や裂け目、破損などの劣化の兆しがあれば、使用しないようにして下さい。
- Fisher & Paykel社製 MR810の加湿器チャンパーとその付属品のみ使用して下さい。
- 加湿器は、必ず、常に患者より低い位置になるようにして下さい。
- 加湿器内には、37℃を超える水を入れないして下さい。
- 換気装置のアラーム設定は、適切に行って下さい。
- 回路の患者側の位置を示す、患者マークに必ずコネクタを接続するようにして下さい。
- 可能であれば、呼吸装置のムムにある除水器を使用します。
- 使用前にチューブの接続が全てしっかり取り付けられているかを確認します。
- 呼吸装置の圧力リークテストを行い、患者に設置する前に接続部分の咬合わせの確認を行います。
- 患者に設置する前に、所定の呼吸装置設定のもと、確実に回路の機能が完全に行われるようにします。
- 回路の配管、腹水の除水器の規則的な作動と排水状態が所定状態であることを確認して下さい。
- 気体流の無い状態で、加熱した呼吸装置回路を使用しないで下さい。気体流が、断続されてしまった場合は、加湿器を止めて下さい。
- 回路を毛布やシーツなどの素材で覆うようなことをしないで下さい。
- 表面温度が、43℃になることがあります。長時間に渡り、患者の皮膚がむきだしの状態で、回路のチューブに接触していると、褥瘡や皮膚損傷を起こすことがあります。
- 回路のチューブを潰さないで下さい。
- 推奨される環境温度や流量範囲外で使用を行うと、本システムの湿度出力動作が障害を起こす場合があります。
- 本装置を改造することは、許可されておりません。
- コネクタ端部からのみ取り外しを行って下さい。チューブを引っ張ったり、振じると、破損の原因となります。
- 加湿器の給水レベルを定期的に確認し、適宜補給を行って下さい。
- チューブを過度な紫外線に曝さないようにして下さい。
- チューブ並びに回路部品は全て、洗浄周期が20回に達した時点もしくは、最初の利用より6ヶ月経過後のいずれか、早い時期に廃棄して下さい。製品の使用期間終了時には、回路を消毒し、非汚染医療ゴミとして廃棄します。

製品保証についての記載事項:

Fisher & Paykel Healthcareは、Evatherm™回路が、本取扱説明書に従って利用された場合は、その操作及び材質に欠陥なく、利用者が購入した日より90日間は、Fisher & Paykel Healthcare の公式に公開されている仕様書に従って、作動することを補償するものです。本保証内容は、下記サイトにて詳細に定める制約並びに特例があれば、そちらに従うものとします。
<http://www.fhpcare.com/evathermwarranty>

한국어



자세한 설치 및 올바른 사용 방법에 대해서는 MR810 가습기 설명서를 참조하십시오.

용도

Fisher & Paykel Healthcare 900MR810 성인용 호흡회로는 지속적인 간헐적인 시스템이나 지속적 가습 시스템 사용 할 때 환자의 흡기 호흡 가스 에치료 수준의 가열 및 가습을 제공하기 위해 MR810 가습기와 함께 사용하도록 설계되었습니다.

환기를 통해 제공되는 차갑고 건조한 호흡 공급 가스를 추가 가열 및 가습하면 환자의 기도 가래 지잡게 하는 데 도움이 됩니다. MR810 시스템은 영문, 장기간 양식 및 가정에서 자격이 있는 의료 전문가의 처방 하에 사용하도록 설계되었습니다.

기호:



환자

세척/살균

아래 지침에 명시되어 있는 승인된 살균 및 세척 방법만 사용하십시오.

- 20회 세척 후 또는 첫 사용 후 6개월 경과 시 기종 하 나 라 도 해당 되면 튜브와 모든 회로 구성 요소를 폐기하십시오. 최대 권장 세척 온도를 초과하지 마십시오. 권장 온도는 보다 높은 온도로 세척 하면 회로가 손상될 수 있습니다. 자동 세척 액/세정제를 사용하지 마십시오. 회로가 손상될 수 있습니다.

세척 및 살균 지침:

1단계-세척:



경고: 세척 시 1회용 장갑, 보호 마스크/보안경, 보호가운 등 적절한 개인 보호 장비를 착용하십시오.

- 회로를 분해 합니다.
 - 참고: 사용 후에는 가능한 한 빨리 회로를 세척하십시오.
- 사용한 직후에 따뜻한 수돗물(40°C 미만)로 회로 구성 요소를 헹굽니다.
- 싱크/컨테이너에 따뜻한 물(40°C 미만)을 담고 차가워 염수 산나트륨을 최대 0.5% 농도로 섞습니다. 그런 다음 튜브와 구성 요소를 30~40분간 담가 둡니다.
- 필요한 경우 부드러운 브러시를 브러시로는 예매이는 모든 피꺼기를 제거하여 튜브 내부부를 세척합니다. 튜브 내부에는 강한 브러시를 사용하지 마십시오.
- 따뜻한 수돗물로 튜브의 내부와 외부를 철저히 행거 서는 차가워 염수 산나트륨과 피꺼기를 제거합니다.
- 튜브를 세로로 똑바로 매달아서 물기를 제거합니다. 튜브는 최대 75°C로 말릴 수 있습니다.



경고: 용매 또는 알코올로 회로를 세척하거나 건조하지 마십시오.

- 2단계의 고수준 살균을 진행하십시오.

2단계 – 고수준 살균

아래의 살균 방법 중 하나를 사용하십시오.

a. 0.3% OPA(오피덱스액)으로 살균합니다.

- 경고:** OPA를 취급하기 전에 1회용 장갑, 보호 마스크/보안경, 보호가운 등 적절한 개인 보호 장비를 착용하십시오. 살균은 증기 흡입 장에서 모든 증기 배출로 실시합니다. OPA 제조사의 사용 설명서를 참조하십시오.

- 싱크/컨테이너에 Johnson and Johnson Cidex OPA와 같은 살균제 OPA를 0.3% 농도로 채웁니다 (OPA의 올바른 분주비 방법에 대해서는 제조사 설명서 참조). 살균제 예뵤브와 구성 요소를 담습니다. 최소 30분간 담가 두었다가 OPA에서 모든 부품을 꺼냅니다.
- 다른 장갑으로 교체하여 착용합니다.
- 살균수 튜브와 구성 요소를 헹굽니다.(OPA를 올바르게 행거 는 절차에 대해서는 제조사 설명서 참조).
- 튜브를 세로로 매달아서 공기 중에 말립니다. 튜브는 최대 75°C에서 공기 중에 말릴 수 있습니다. 튜브와 회로 구성 요소를 검사하고, 갈라지거나 찢어지거나 손상되지 않았는지 확인합니다. 모든 구성 요소가 마른 연 호흡 회로를 다시 조립합니다. 회로는 다음에 사용할 수 있도록 건조하고 먼지가 없는 곳에 보관합니다.

b. 저온 살균법으로 살균:

- 살균기가 75-78°C(최대) 사이로 체어 되도록 설정해야 합니다.
 - 참고: 온도를 78°C 이상으로 높이면 호흡 튜브가 손상되고 고수영이 단축됩니다.
- 저온 살균기의 회로 구성 요소를 30~40분간 둡니다.
- 회로 구성 요소를 제거하여 튜브를 세로로 매달아야 합니다. 튜브는 최대 75°C에서 말릴 수 있습니다. 튜브와 회로 구성 요소를 검사하고, 갈라지거나 찢어지거나 손상되지 않았는지 확인합니다. 모든 구성 요소가 마른 연 호흡 회로를 다시 조립합니다. 회로는 다음에 사용할 수 있도록 건조하고 먼지가 없는 곳에 보관합니다.

c. 가압 증기 멸균기:

- 경고:**회로 커넥터가 압증기 멸균할 수 없습니다. 가압 증기 멸균은 튜브를 파손 시킬 수 있습니다.

- 가압 증기 멸균기가 121°C 또는 136°C로 설정되어 있는지 확인합니다. 가압 증기 멸균기에서 회로 커넥터를 121°C에서 30분간 두거나 136°C에서 4분간 둡니다. 회로 커넥터를 검사하여 갈라지거나 손상되지 않았는지 확인합니다. 모든 커넥터가 마른 연 회로 커넥터를 살균 튜브에 다시 조립합니다. 회로는 다음에 사용할 수 있도록 건조하고 먼지가 없는 곳에 보관합니다.

기술적 규격:



BF 유형

인터페이스 연결: ISO 5356-1 또는 ISO 5367

주위 온도 및 인입 가스 작동 범위: 18℃ – 26℃

최대 공급 온도: 40°C 미만

	9 0MR81
순응도:	4.6mL/kPa/m
압축 가능 부피:	640mL
누수 속도:	25mL/min @ 6kpa 미만
정격 유량에서 유량에 대한 저항:	0.4cmH ₂ O @ 60 ± 1L/min
유량 범위:	≥5 ~ ≤60 L/min *

- MR370 가습물통으로 테스트됨



경고:

- 환자마다 사용 전 후에 승인된 살균 방법만 사용하여 회로 구성 요소를 세척하십시오. 승인되지 않은 세척 방법을 사용하면 회로가 손상되고 사용 가능한 수명이 줄어들 수 있습니다.
- 숙련된 의료 전문가가 설정 및 사용해야 합니다.
- 다시 사용하기 전에 회로를 검사하여 회로에 갈라지거나 찢어지거나 손상된 흔적이 있는 경우 사용하지 마십시오.
- Fisher & Paykel MR810, 가습물통 및 주변 기기에만 사용합니다.
- 가습기가 항상 환자보다 아래에 있어야 합니다.
- 가습물통에 37°C 보다 높은 온도의 물을 채우면 안 됩니다.
- 적절한 온도 호흡기 튜브를 설정합니다.
- 환기 호가 있는 커넥터가 회로의 환자 부분에 위치하는지 확인합니다.
- 적절한 경우 후기 튜브의 워터 트랩을 사용합니다.
- 사용하기 전에 모든 튜브 연결이 조여 있는지 확인합니다.
- 환자에게 연결하기 전에 호흡 시스템에 대해 알력 및 누수 테스트를 수행하고 혈관 폐색 증상이 없는지 확인합니다.

- 환자에 연결하기 전에 필요한 인공 호흡기 설정으로 전체 회로가 올바르게 작동하는지 확인합니다.
- 회로 튜브 및 워터 트랩에 응축액이 맺히지는지 정기적으로 확인하고 필요한 경우 응축액을 빼십시오.
- 가스가 흐르고 있지 않을 때는 열선 호흡 회로를 사용하지 마십시오.
- 가습 흐름이 중단되면 가습기의 전원 플러그를 끄십시오.
- 회로를 담요, 수건 또는 침대보와 같은 물건으로 덮지 마십시오.
- 표면 온도가 43°C에 도달할 수 있습니다.
- 회로 튜브에 환자 피부 부를 정기적으로 접촉시키면 압력의 향상 또는 피부 손상이 발생할 수 있습니다.
- 회로 튜브를 누르지 마십시오.
- 관장 주변 온도나 유량 범위를 초과하여 사용하면 이 시스템의 습도 출력률이 손상될 수 있습니다.
- 이 가습기는 어떤 형태든 두 구조를 변경해서는 안 됩니다.
- 결의 커넥터 단말점 분리하십시오. 손상될 수 있으므로 호흡 장치가 망가거나 꼬이지 마십시오.
- 가습물통의 물 수위를 정기적으로 확인하고 필요한 경우 가득 채우십시오.
- 튜브를 과도한 UV 방사선에 노출하지 마십시오.
- 20회 세척 후 또는 첫 사용 후 6개월 경과 시 기종 하 나 라 도 해당 되면 튜브와 모든 회로 구성 요소를 폐기하십시오. 제품 수명이 다하면 회로를 살균한 후 영도 영되지 않은 의료 폐기물로 처리하십시오.

보증:

Fisher & Paykel Healthcare는 Evatherm™ 회로를 사용 지침에 따라 사용할 경우 이 회로의 기술 및 재질 면에서 오류가 없으며 최종 사용자가 구입한 날로부터 90일간 Fisher & Paykel Healthcare의 공식 발표된 제품 사양에 따라 작동한다는 것을 보증합니다. 이 보증 내용은 다음에 자세히 명시되어 있는 제한 사항 및 예외에 따라 달라질 수 있습니다.
<http://www.fhpcare.com/evathermwarranty>

中文



有关进一步设置和正确使用信息，请参阅MR810呼吸湿化器用户说明书。

指定用途

按设计，费雪派克（Fisher & Paykel Healthcare）900MR810 成人呼吸管路适合与MR810呼吸湿化系统配合使用，以便在使用持续或间断呼吸机系统或持续气流系统时，将病人吸入气体加温加湿至治疗水平。

对呼吸系统送出的寒冷干燥呼吸气体进行加温加湿有助于防止病人气道干燥。MR810呼吸湿化系统可在医院、长期护理机构和家里使用，但需在合格专业医务人员 的指示下使用。

符号:



病人端

清洁/消毒

按这些指示所述，只使用认可的消毒和清洁方法：



在清洁20次后，或第一次使用后六个月（以先到者为准），丢弃呼吸管和所有管路组件。不要超过最高推荐清洁温度，因为较高的清洁温度可能会损坏呼吸管路。不要使用自动洗碗机/清洁机，因为这可能会损坏呼吸管路。

清洁和消毒说明:

第一步 – 清洁:



注意: 当清洁时，请穿戴适宜的个人防护设备，比如：一次性手套、防溅面罩/防护镜和防护服。

- 拆开呼吸管路
 - 注: 使用后尽快清洁管路。
- 使用后用温水（<40℃）直接冲洗呼吸管路组件。
- 在一个水池/容器中倒入温水(<40℃和次氯酸钠（浓度不超过0.5%）。然后，浸泡管路和组件 30~40分钟。
- 清洁管路内部，清除所有可见的碎屑，需要时使用软刷刷。不要在管路内部使用硬刷子。
- 以温水彻底冲洗管路内外部，以除去残留的次氯酸钠和碎屑。
- 将管路垂直悬挂以滴去多余水分。管路可在高达75℃温度下风干。



警告: 不要使用溶剂或乙醇清洁或干燥管路。

- 转至第二步高水平消毒。

第二步 – 高水平消毒:

使用所示消毒方法之一：

a. 使用0.3%邻苯二甲酰(OPA)化学剂消毒:

- 注意:**在操作OPA前穿戴适当的个人防护物质，比如：一次性手套、防溅面罩/防护镜和防护服。确保在通风柜或者能通风处消毒。阅读OPA生产厂商使用说明书。

- 在水池/容器中倒入消毒剂0.3%的OPA，比如强生公司的戊二碱Cidex OPA（遵照厂商指示正确配置OPA）。将管路和组件完全浸泡在消毒液中。至少浸泡30分钟。然后从OPA液中取出所有的部件。
- 更换手套。
- 使用无菌水冲洗管路和部件（遵照厂商有关OPA正确冲洗程序的指导）。
- 垂直悬挂管路让其风干。管路可在高达75℃温度下风干。检查管路和管路组件，检查有否破裂或裂缝或损坏。所有组件干燥后重新组装呼吸管路。将呼吸管路存放在干燥无尘的环境中以备下次使用。

b.巴氏灭菌:

- 确保巴氏灭菌器设置控制温度75和最高78℃之间。
 - 注：温度超过78℃将会损坏呼吸管并缩短其寿命。
- 让管路组件在巴氏灭菌器中消毒30至40分钟。
- 取出管路组件，垂直悬挂管路让其干燥。管路可在高达75℃温度下风干。检查管路和管路组件，检查有否破裂或裂缝或损坏。所有组件干燥后重新组装呼吸管路。将呼吸管路存放在干燥无尘的环境中以备下次使用。

c.高压灭菌:



警告: 只有呼吸管路接头才可高压灭菌。高压灭菌将损坏管路。

- 确保高压灭菌温度设置在121℃或136℃。让呼吸管路接头在高压灭菌器中消毒121℃下30分钟或136℃下4分钟。检查管路接头，检查有否破裂或损坏。当所有接头干燥后，重新将接头组装至已消毒管路。将呼吸管路存放在干燥无尘的环境中以备下次使用。

技术规格:



BF类型

界面连接: ISO 5356-1或ISO 5367

环境温度和气体输入操作范围: 18℃–26℃

最高输出温度: <40℃

	900MR810
符合:	4.6 mL/kPa/m
可变容积:	640 mL
时的漏气量:	<25 mL/min @ 6千帕
额定流量下的阻力:	0.4 cmH ₂ O @ 60 ± 1 L/min
流量范围:	≥5 to≤60 L/min*

- 以MR370湿化水罐测试



警告:

- 在使用前及每量病人使用后清洁呼吸管路，且只使用认可的消毒方法。使用未经认可的消毒方法可损坏呼吸管路并缩短其使用寿命。
- 必须由受培训的医疗专业人员设置和使用。
- 在重新使用前检查管路，如管路显示老化迹象请勿使用，比如：破裂、裂缝或损坏。
- 只使用费雪派克（Fisher & Paykel）MR810、湿化水罐和附件。
- 确保呼吸湿化器放置的位置始终低于病人位置之下。
- 不要往湿化水罐里加入超过37℃的水。
- 设置合适的呼吸机报警参数。
- 确保带病人符号的接头位于管路的病人端。
- 如果需要，在呼吸管路中加用集水杯。
- 使用前检查所有管路连接确保紧密。
- 在连接到病人之前需对系统进行压力和漏气测试，以检查系统是否有堵塞。
- 在连接到病人前，确保在所需呼吸机设置下呼吸管路功能完全正常。
- 定期检查呼吸管路和集水杯的冷凝水，必要时排掉。
- 请勿在没有气流的情况下使用加热呼吸管路。如气流中断，请关闭呼吸湿化器。
- 不要用毯子、毛巾或床单等物品覆盖在呼吸管路上。
- 表面温度可达43℃。病人裸露皮肤与管路长时间接触可导致压伤或皮肤损伤。
- 不要挤压呼吸管路。
- 如在推荐的环境温度或流量范围外使用，本系统的湿度输出可受影响。
- 不允许改装本系统。
- 只能握住端头拆除管路，不得牵拉或扭转管路，因为这样可能造成损坏。
- 定期检查湿化水罐中的水位，及时加满。
- 不要将管路暴露在紫外线（UV）辐射下。
- 在清洁20次后，或从第一次使用后六个月（以先到者为准，呼吸管路和组件应弃置。管路到达使用寿命后，请先消毒，然后按照未污染医疗废物处理。

保修声明:

费雪派克医疗保健公司保证，费雪派克医疗保健公司的Evatherm™呼吸管路，在按照使用说明使用的情况下，不存在工艺和材料缺陷，且会自终端用户购买之日起按照费雪派克医疗保健公司正式公布的产品规格正常运行九十(90)日。保修期受公司相关限制性条款和额外条件制约，详见http://www.fhpcare.com/evatherm_warranty

国食药监械（进）字2014第25600331号
YZB/NZE 7644-2013《呼吸湿化器》

Română

ro



Consultați instrucțiunile de utilizare a umidificatorului MR810 pentru informații detaliate despre instalare și utilizare corectă.

Utilizare prevăzută

Circuitul respirator pentru adulți Fisher & Paykel Healthcare 900MR810 este conceput pentru utilizarea cu umidificatorul MR810 pentru a furniza niveluri terapeutice de căldură și umiditate gazelor respiratorii inspirate de pacient, atunci când se utilizează un sistem de ventilație continuu sau intermitent ori un sistem cu debit continuu de gaze.

Adăugarea de căldură și umiditate în amestecul rece și uscat de gaze respiratorii furnizate prin intermediul ventilației este benefică pentru prevenirea uscării căilor respiratorii ale pacientului. Sistemul MR810 este proiectat pentru a fi utilizat în spitale, în unități de îngrijire pe termen lung și la domiciliu, cu prescripție medicală din partea unui cadru medical calificat.

Simbol:



Capătul dinspre pacient

Curățare/Dezinfectare

Utilizați numai metodele de dezinfectare și curățare aprobate, în conformitate cu precizările din aceste instrucțiuni:



Aruncați tuburile și toate componentele circuitului după 20 de cicluri de curățare, sau la șase luni de la prima utilizare, oricare dintre acestea are loc mai devreme. Nu depășiți valorile maxime recomandate ale temperaturii de curățare, deoarece temperaturile ridicate de curățare pot deteriora circuitul. Nu utilizați mașina de spălat/curățat automată întrucât acest lucru ar putea deteriora circuitul.

Instrucțiuni de curățare și dezinfectare:

Pasul 1 – Curățarea:



Atenție: Când efectuați curățarea, purtați echipament adecvat de protecție individuală, cum ar fi: mănuși de unică folosință, vizieră de protecție împotriva stropirii/ochelari de protecție și halat de protecție.

- Demontați circuitul.

NOTĂ: Curățați circuitul cât mai curând posibil după utilizare.
- Clătiți componente circuitului imediat după utilizare, cu apă caldă de la robinet (<40 °C). Umpleți chiuveta/un vas cu apă caldă (<40 °C) și hipoclorit de sodiu la o concentrație de maxim 0,5%. Înmuiați apoi tubulatura și componentele timp de 30 – 40 minute.
- Curățați interiorul tubului îndepărtând toate resturile vizibile, utilizând dacă este necesar o perie moale cum sunt cele pentru sticle. Nu folosiți perii dure în interiorul tubului.
- Clătiți bine interiorul și exteriorul tubului, cu apă caldă de la robinet, pentru a îndepărta hipocloritul de sodiu și detritusurile rămase.
- Suspendați tuburile în poziție verticală pentru a îndepărta excesul de apă. Tuburile pot fi uscate cu aer până la 75 °C.



Avertisment: Nu curățați și nu uscați circuitul cu solvenți sau alcool.

- Continuați cu dezinfectarea de nivel înalt, pasul 2.

Pasul 2 – Dezinfectarea de nivel înalt:

Utilizați una dintre metodele de dezinfectare prezentate:

a. Dezinfectare chimică cu ortoftalaldehidă (OPA) 0,3%:



Atenție: Înainte de a manipula OPA Purtați articole adecvate de protecție individuală, cum ar fi: mănuși de unică folosință, vizieră de protecție împotriva stropirii/ochelari de protecție și halat de protecție. Asigurați-vă că dezinfectarea se efectuează într-o etuvă sau cu un sistem de aspirare a vaporilor. Citiți instrucțiunile de utilizare a OPA oferite de producător.

- Umpleți chiuveta/vasul cu un dezinfectant OPA 0,3%, cum ar fi OPA Cidex Johnson and Johnson (urmați instrucțiunile producătorului pentru prepararea corectă a OPA). Imersați tubul și componentele complet în dezinfectant. Lăsați la înmuiat timp de cel puțin 30 de minute. Scoateți apoi toate piesele din OPA.
- Schimbați mănușile.
- Clătiți tuburile și componentele cu apă sterilă (urmați instrucțiunile producătorului pentru procedura de clătire corectă în cazul utilizării OPA).
- Suspendați tuburile în poziție verticală pentru a le lăsa să se usuce la aer. Tuburile pot fi uscate cu aer până la 75 °C. Inspectați tubulatura și componentele circuitului, verificați să nu existe fisuri, rupturi sau deteriorări. După ce s-au uscat toate componentele, reasamblați circuitul respirator. Păstrați circuitul într-un mediu uscat și fără praf, până la următoarea utilizare.

b. Dezinfectarea prin pasteurizare:

- Asigurați-vă că aparatul de pasteurizare este setat între 75 și 78 °C maxim.

NOTĂ: Temperaturile mai mari de 78 °C vor deteriora tubul de respirat și vor scurta durata de viață a acestuia.

Lăsați componentele circuitului în aparatul de pasteurizare pentru o durată de timp între 30 și 40 de minute.
- Scoateți componentele circuitului, suspendați tubulatura vertical pentru a o lăsa să se usuce. Tuburile pot fi uscate cu aer până la 75 °C. Inspectați tubulatura și componentele circuitului, verificați să nu existe fisuri, rupturi sau deteriorări. După ce s-au uscat toate componentele, reasamblați circuitul respirator. Păstrați circuitul într-un mediu uscat și fără praf, până la următoarea utilizare.

c. Autoclavare:



Avertisment: Numai conectorii circuitului pot fi introduși în autoclavă. Autoclavarea va distruge tubulatura.

- Asigurați-vă că autoclava este setată la 121 °C sau la 136 °C. Lăsați conectorii circuitului în autoclavă timp de 30 de minute la 121 °C sau 4 minute la 136 °C. Inspectați conectorii circuitului, verificați să nu existe fisuri sau deteriorări. După ce s-au uscat toate componentele, reasamblați conectorii circuitului la tubulatura dezinfectată. Păstrați circuitul într-un mediu uscat și fără praf, până la următoarea utilizare.

Specificații tehnice:



Tip BF

Conexiunile pentru interfață: ISO 5356-1 sau ISO 5367
Intervalul regimului de temperatură ambientală și de admisie gaz: 18 °C – 26 °C
Temperatura maximă furnizată: <40 °C

	900MR810
Conformitate:	4,6 mL/kPa/m
Volum compresibil:	640 mL
Debit pierderi:	<25 mL/min la 6 kpa
Rezistența la debitul nominal:	0,4 cmH ₂ O la 60 ± 1 L/min
Interval debit:	≥5 până la ≤60 L/min *

* Testat cu camera MR370



Avertisment:

- Curățați circuitul înainte de utilizare și după fiecare utilizare la pacient, folosind numai metode de dezinfectare aprobate. Utilizarea metodelor de curățare neaprobate poate duce la deteriorarea circuitului și la reducerea duratei de viață utilă a acestuia.
- Circuitul trebuie să fie configurat și utilizat de către un cadru medical instruit.
- Verificați circuitul înainte de a-l reutiliza; nu folosiți circuitul dacă acesta prezintă semne de deteriorare, cum ar fi: fisuri, rupturi sau defecte.
- Folosiți numai cu camere de umidificare și accesorii MR810 Fisher & Paykel.
- Asigurați-vă că umidificatorul este întotdeauna poziționat mai jos decât pacientul.
- Nu umpleți camera de umidificare cu apă la o temperatură mai mare de 37 °C.
- Reglați alarmele adecvate ventilatorului.
- Asigurați-vă că conectorul cu simbolul pacient este situat la capătul dinspre pacient al circuitului.
- Utilizați o capcană de apă înramul de expir atunci când este cazul.
- Verificați ca toate conexiunile tubului să fie bine fixate înainte de utilizare.
- Înainte de conectarea la pacient, testați sistemul de ventilație cu privire la presiune și pierderea de gaz, și verificați să nu existe blocaje.
- Asigurați-vă că întregul circuit funcționează corect, cu setările pentru ventilator necesare, înainte de conectarea la un pacient.
- Verificați în mod regulat tubulatura circuitului și capcanele de apă pentru condens; eliminați apa conform necesităților.
- Nu folosiți circuitul de respirat cu încălzire fără debit de gaz. Dacă debitul de gaz este întrerupt, opriți umidificatorul.
- Nu acoperiți circuitul cu materiale precum pătură, prosoape sau lenjerie de pat.
- Temperatura la suprafață poate ajunge la 43 °C. Contactul prelungit al pielii expuse a pacientului, cu tubulatura circuitului poate duce la leziuni prin presiune sau leziuni tegumentare.
- Nu striviți tubulatura circuitului.
- Eliminarea umidității din acest sistem poate fi împiedicată dacă este folosit în afara limitelor recomandate pentru temperatura ambientală sau a celor pentru debit.
- Este interzisă orice modificare adusă acestui aparat.
- Deconectați tubul înănd doar de conectorii de la capete, nu trageți și nu răsuciți tubulatura, deoarece acest lucru poate duce la deteriorări.
- Verificați în mod regulat nivelul apei în camera de umidificare și suplimentați în funcție de necesități.
- Nu expuneți excesiv tuburile la radiații UV.
- Aruncați tuburile și toate componentele circuitului după 20 de cicluri de curățare, sau la șase luni de la prima utilizare, oricare dintre acestea are loc mai devreme. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dezinfectați circuitul, apoi eliminați ca deșeu medical necontaminat.

Declarație privind garanția:

Fisher & Paykel Healthcare garantează că circuitul Evatherm™, atunci când este utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, nu va prezenta defecte de manipulare, respectiv de materiale, și va funcționa în conformitate cu specificațiile oficiale pentru produs Fisher & Paykel Healthcare publicate, pentru o perioadă de 90 de zile de la data achiziționării de către utilizatorul final. Această garanție este supusă limitărilor și excepțiilor precizate în detaliu pe

<http://www.fphcare.com/evathermwarranty>

Slovensky

sk



Bližšie informácie týkajúce sa nastavenia a správneho použitia nájdete v pokynoch pre používateľa k zvlhčovaču MR810.

Určené použitie

Dýchací okruh Fisher & Paykel Healthcare 900MR810 určený pre dospelých je navrhnutý na použitie so zvlhčovačom MR810, aby poskytoval terapeutické úrovne teploty a vlhkosti respiračným plynom vdychovaným pacientom pri použití nepretržitého alebo prerušovaného ventilačného systému alebo nepretržitého systému prietoku plynu.

Pridanie tepla a vlhkosti do prívodu chladných a suchých respiračných plynov dodávaných prostredníctvom ventilačie je užitočné najmä na zabránenie vysušenia dýchacích ciest pacienta. Systém MR810 je navrhnutý na použitie v nemocniciach, zariadeniach s dlhodobou starostlivosťou a domácnostiach na základe predpisu kvalifikovaného lekárskeho odborníka.

Symbol:



Pacientsky koniec

Čistenie/dezinfekcia

Používajte len schválené dezinfekčné a čistiace metódy, ktoré sú uvedené v týchto pokynoch:



Hadice a všetky komponenty okruhu zlikvidujte po 20 čistiacich cykloch alebo po šiestich mesiacoch od prvého použitia (podľa toho, čo nastane skôr). Neprekračujte maximálne odporúčané teploty čistenia, pretože vyššie teploty čistenia môžu poškodiť okruh. Nepoužívajte automatickú práčku/čističku, pretože to by mohlo poškodiť okruh.

Pokyny na čistenie a dezinfekciu:

Krok 1 – čistenie:



Upozornenie: Počas čistenia noste vhodné osobné ochranné prostriedky, ako sú jednorazové rukavice, ochranný štít proti špliechaniu / bezpečnostné okuliare a ochranný plášť.

- Demontujte okruh.

POZNÁMKA: Vyčistite okruh ihneď po použití.
- Opláchnite komponenty okruhu priamo po ich použití teplou tečúcou vodou (<40 °C).
- Naplňte umývadlo/nádobu zmesou teplej vody (<40 °C) a chlórnanu sodného s maximálnou koncentráciou 0,5 %. Potom namočte hadicu aj komponenty na 30 – 40 minút.
- Vyčistite vnútro hadice pomocou jemnej kefy na fľaše, pričom, podľa potreby, odstráňte všetko viditeľné znečistenie. Na vnútro hadice nepoužívajte tvrdé kefy.
- Dôkladne opláchnite vnútro a vonkajšok hadice teplou tečúcou vodou, aby ste odstránili zvyšky chlórnanu sodného a znečistenia.
- Zaveste hadice zvislo tak, aby ste odstránili zvyšnú vodu. Hadice možno sušiť vzduchom na vzduchu pri teplote do 75 °C.



Varovanie: Nečistite ani nevysušajte okruh rozpúšťadlami ani alkoholom.

- Prejdite na dezinfekciu vysokej úrovne, na krok 2.

Krok 2 – dezinfekcia vysokej úrovne:

Použite jednu z nasledujúcich dezinfekčných metód:

a. Dezinfekcia pomocou 0,3 % ortoftalaldehydu (OPA):



Upozornenie: Pred manipuláciou s OPA Oblečte si vhodné osobné ochranné prostriedky, ako sú jednorazové rukavice, ochranný štít proti špliechaniu / bezpečnostné okuliare a ochranný plášť. Zabezpečte, aby sa dezinfekcia vykonávala v odsávači pár alebo pri zapnutom odsávači pár. Prečítajte si pokyny na použitie od výrobcu OPA.

- Naplňte umývadlo/nádobu 0,3 % dezinfekčným prostriedkom OPA, ako je napr. Johnson and Johnson Cidex OPA (postupujte podľa pokynov výrobcu na správnu prípravu OPA). Hadicu a komponenty ponorte úplne do dezinfekčného prostriedku. Nechajte ich namočené po dobu 30 minút. Potom z OPA vyberte všetky časti.
- Vymeňte si rukavice.
- Opláchnite hadicu a komponenty sterilizovanou vodou (postupujte podľa pokynov výrobcu na správny postup oplachovania OPA).
- Zaveste hadice zvislo a nechajte ich vyschnúť na vzduchu. Hadice možno sušiť vzduchom pri teplote do 75 °C. Skontrolujte hadice a komponenty okruhu, či nie sú prasknuté, poškodené, alebo nemajú trhliny. Keď sú všetky komponenty suché, znova zostavte dýchací okruh. Skladujte okruh na suchom mieste bez prachu, kde bude pripravený na ďalšie použitie.

b. Dezinfekcia pasterizáciou:

- Zabezpečte, aby bol pasterizátor nastavený na maximálnu teplotu 75 až 78 °C.

POZNÁMKA: Vyššia teplota ako 78 °C poškodí dýchaciu hadicu a skráti jej životnosť.

Ponechajte komponenty okruhu v pasterizátore po dobu 30 až 40 minút.
- Vyberte komponenty okruhu a hadice zaveste zvislo tak, aby vyschli. Hadice možno sušiť na vzduchu pri teplote do 75 °C. Skontrolujte hadice a komponenty okruhu či nie sú prasknuté, poškodené, alebo nemajú trhliny. Keď sú všetky komponenty suché, znova zostavte dýchací okruh. Skladujte okruh na suchom mieste bez prachu, kde bude pripravený na ďalšie použitie.

c. Autoklávanie:



Varovanie: Autoklávať možno len konektory okruhu. Autoklávanie poškodí hadice.

- Zabezpečte, aby bol autokláv nastavený na teplotu buď 121 °C, alebo 136 °C. Nechajte konektory okruhu v autokláve po dobu 30 minút pri teplote 121 °C alebo 4 minúty pri teplote 136 °C. Skontrolujte hadice a komponenty okruhu či nie sú prasknuté, poškodené, alebo nemajú trhliny. Keď sú všetky konektory uschnú, znova pripojte konektory okruhu k vydezinfikovanej hadici. Skladujte okruh na suchom mieste bez prachu, kde bude pripravený na ďalšie použitie.

Technické špecifikácie:



Typ BF

Pripojky rozhrania: ISO 5356-1 alebo ISO 5367
Teplota okolia a prevádzkový rozsah prívodného plynu: 18 °C – 26 °C
Maximálna dodávaná teplota: <40 °C

	900MR810
Zhoda:	4,6 mL/kPa/m
Stlačiteľný objem:	640 mL
Miera netesnosti:	<25 mL/min pri 6 kpa
Odpor prietoku pri menovitom prietoku:	0,4 cmH ₂ O pri 60 ± 1 L/min
Prietokový rozsah:	≥5 až ≤60 L/min *

* Testované s komorou MR370



Varovanie:

- Pred použitím a po každom použití pacientom okruh vyčistite len pomocou schválených dezinfekčných postupov. Použitie neschválených čistiacich metód môže poškodiť okruh a znížiť jeho životnosť.
- Nastavenie a použitie je povolené len školeným zdravotníckym odborníkom.
- Pred použitím okruhu skontrolujte. Nepoužívajte okruh v prípade, ak sa na ňom nachádzajú znaky poškodenia, ako sú praskliny, trhliny alebo iné poškodenie.
- Používajte len so zvlhčovacími komorami a príslušenstvom Fisher & Paykel MR810.
- Zabezpečte, aby bol zvlhčovač umiestnený vždy nižšie ako pacient.
- Neplňte komoru vodou s teplotou vyššou ako 37 °C.
- Nastavte príslušné alarmy ventilátora.
- Zabezpečte, aby bol konektor so symbolom pacienta umiestnený na pacientskom konci okruhu.
- V prípade potreby použite odlučovač vody vo výdychovej vetve.
- Pred použitím skontrolujte, či sú všetky pripojenia trubice tesné.
- Pred pripojením k pacientovi vykonajte na dýchacom systéme test tlaku a tesnosti a skontrolujte oklúzie.
- Pred pripojením k pacientovi zabezpečte, aby celý okruh fungoval správne, s požadovanými nastaveniami ventilátora.
- Pravidelne kontrolujte hadice okruhu a odlučovače vody ohľadom kondenzátu, ktorý vypúšťajte podľa potreby.
- Nepoužívajte vyhrievaný dýchací okruh bez prietoku plynu. Ak je prietok plynu prerušený, vypnite zvlhčovač.
- Okruh nezakrývajte materiálmi, ako sú prikrývky, uteráky alebo posteľné plachty.
- Teplota povrchu môže presiahnuť 43 °C. Dlhší kontakt hadice okruhu s odhalenou pokožkou pacienta môže zapríčiniť poranenie tlakom alebo poškodenie pokožky.
- Hadicu okruhu nestláčajte.
- Výstup vlhkosti tohto systému môže byť narušený, ak sa systém používa mimo odporúčaného rozsahu teploty okolia a prietokového rozsahu.
- Nepovoľujú sa žiadne úpravy tohto zariadenia.
- Hadicu odpájajte len prostredníctvom koncových konektorov. Hadicunefahajte ani neskrúčajte, pretože to môže spôsobiť poškodenie.
- Pravidelne kontrolujte úroveň vody v komore zvlhčovača a v prípade potreby ju doplňte.
- Nevystavujte hadicu nadmernému UV žiareniu.
- Hadice a všetky komponenty okruhu zlikvidujte po 20 čistiacich cykloch alebo po šiestich mesiacoch od prvého použitia (podľa toho, čo nastane skôr). Na konci životnosti okruhu vydezinfikujte a potom ho zlikvidujte ako nekontaminovaný lekársky odpad.

Vyhľadanie o záruke:

Spoločnosť Fisher & Paykel Healthcare zaručuje, že sa na okruhu Evatherm™, ak sa používa v súlade s príslušnými pokynmi na použitie, nevyskytnú žiadne poškodenia spracovania či materiálu a že bude pracovať v súlade s oficiálnymi publikovanými produktovými špecifikáciami spoločnosti Fisher & Paykel Healthcare po dobu 90 dní od dátumu zakúpenia koncovým používateľom. Táto záruka podlieha obmedzeniam a výnimkám, ktoré sú podrobne uvedené na stránke

<http://www.fphcare.com/evathermwarranty>